

MEDVIE


Date du test: 15/07/2024 12:59:14

Durée: 2mn 58s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO OUMAR BAILO	
Date de naissance	01/01/1996
Age	28
Société	CHEC
ID	24071512564046333

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

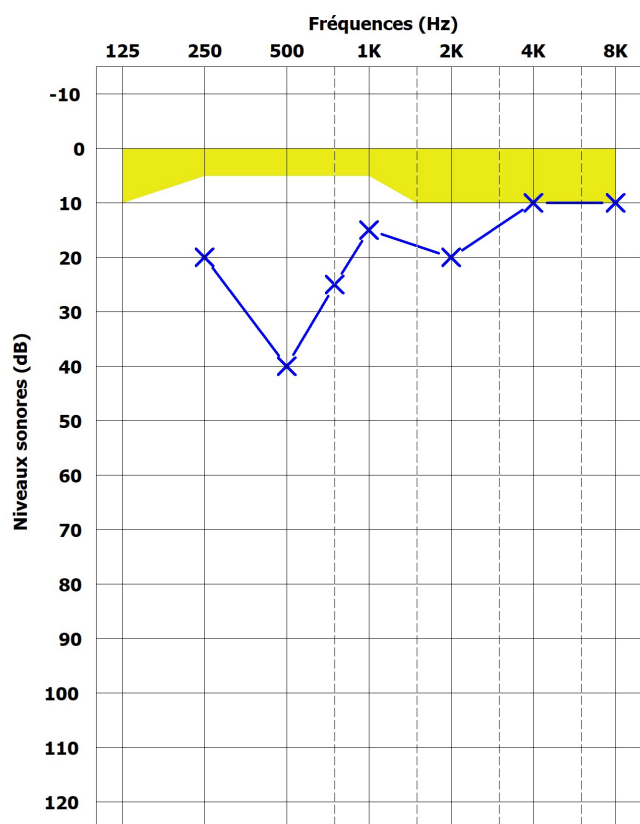

Oreille Gauche

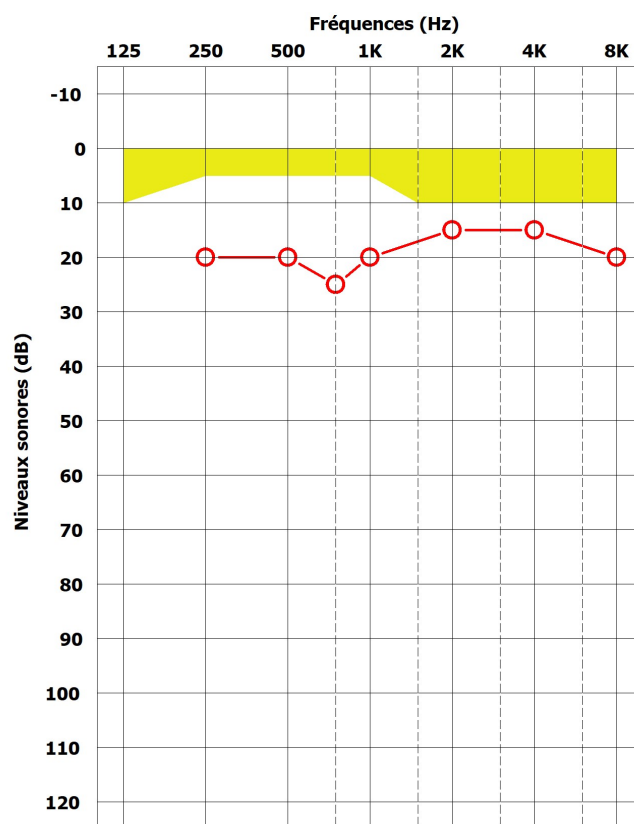

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	40	25	15		20		10		10
CA Droit		20	20	25	20		15		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes