



Données Patient		MANSARAY FODE
Date de naissance	15/02/2000	
Age	24	
Société	CHEC	
ID	24070612094758454	

Date du test: 06/07/2024 12:12:31
Durée: 5mn 29s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

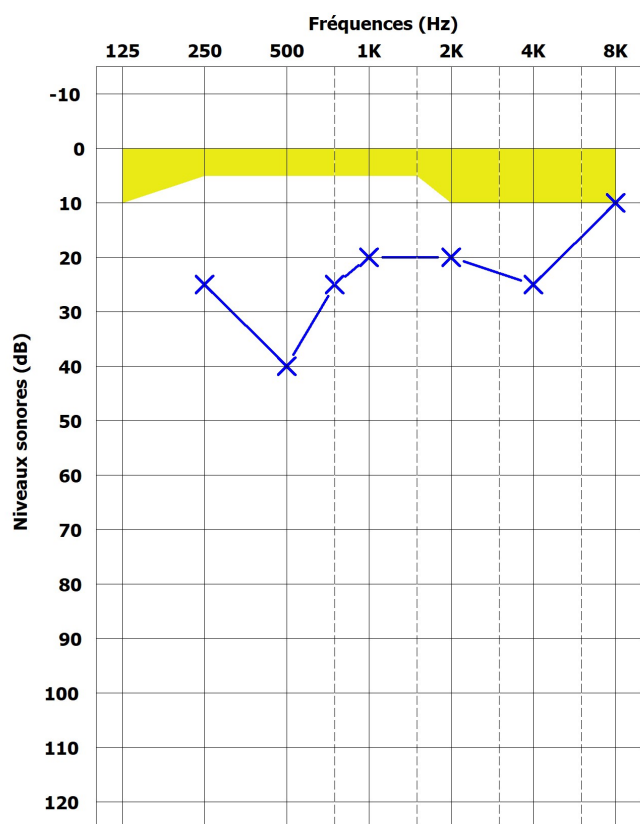

Oreille Gauche

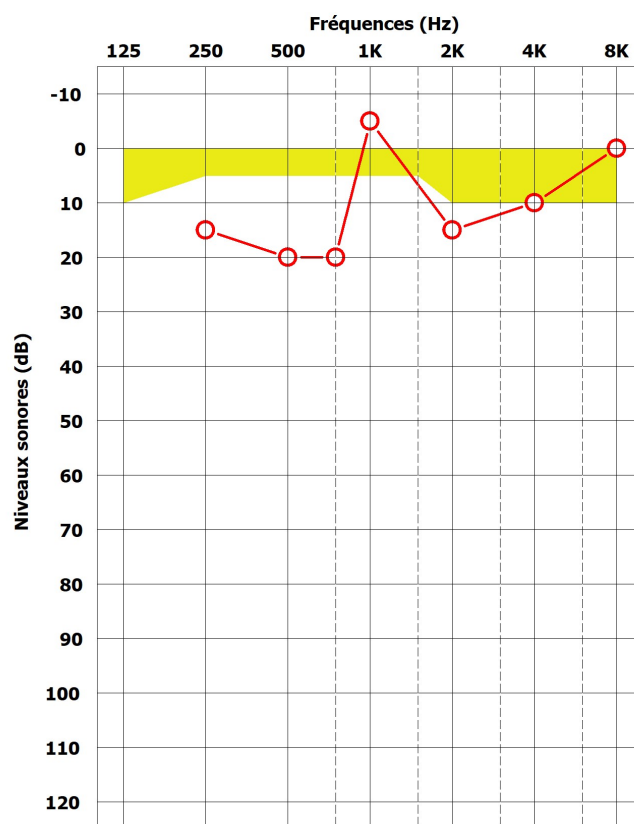

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	40	25	20		20		25		10
CA Droit		15	20	20	-5		15		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes