

MEDVIE


Date du test: 17/07/2024 15:32:40

Durée: 4mn 00s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA MOHAMED
Date de naissance	01/11/2003
Age	20
Société	CHEC
ID	24071715301697276

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

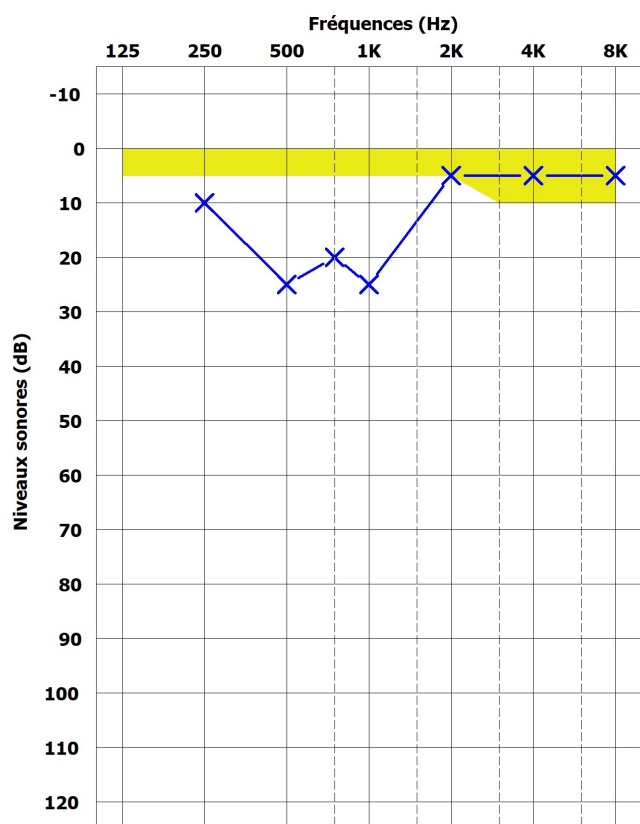

Oreille Gauche

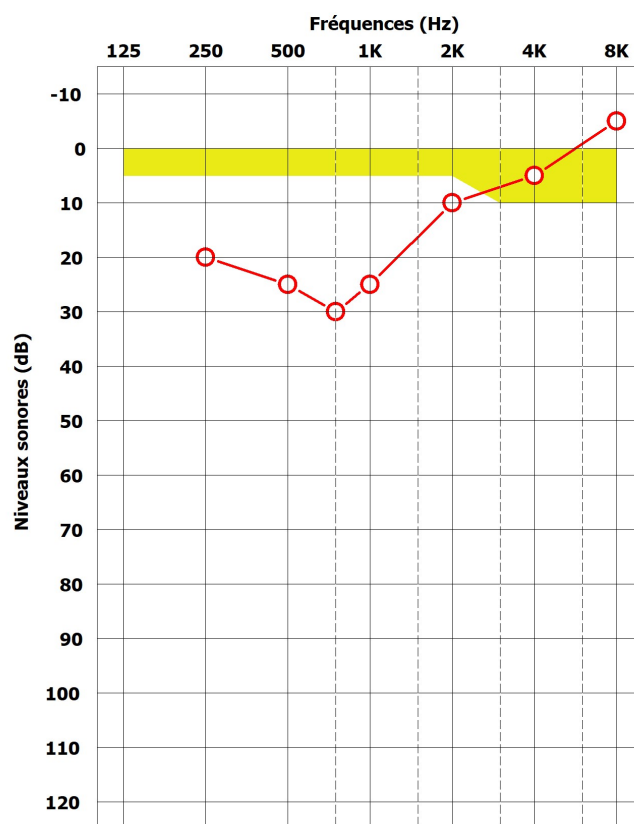

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	20	25		5		5		5
CA Droit		20	25	30	25		10		5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes