
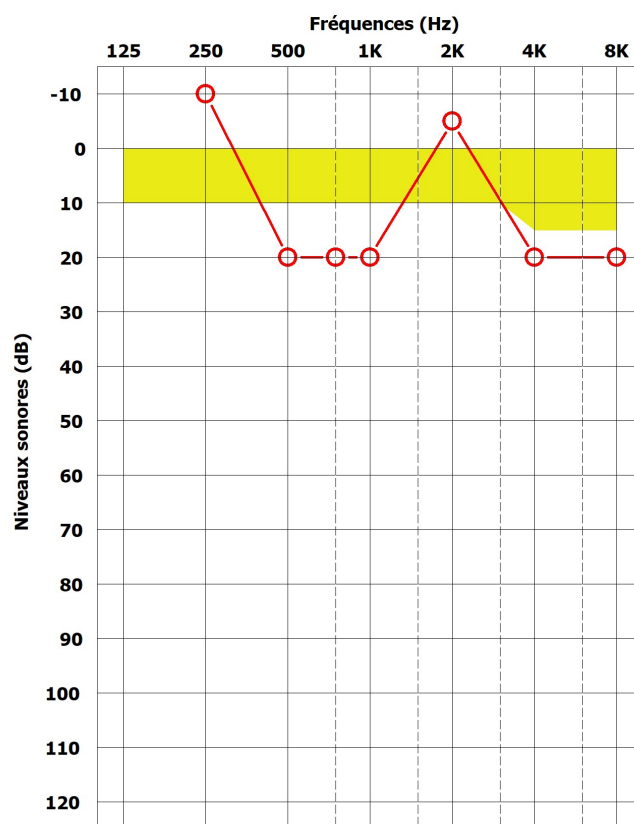


MED VIE

Date du test: 14/09/2024 12:31:40
Durée: 4mn 09s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA IBRAHIMA	
Date de naissance	01/01/1991
Age	33
Société	CHEC
ID	24091412293294775

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

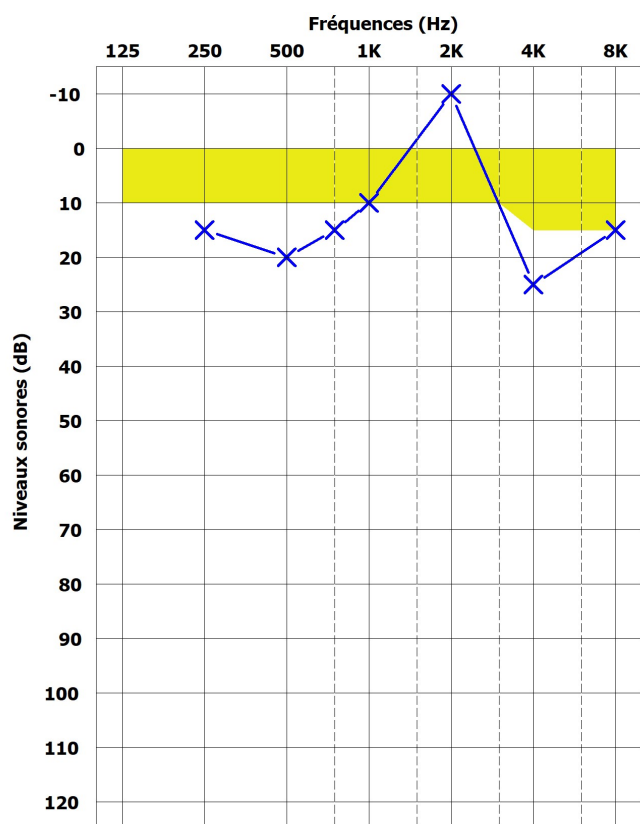

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	15	10		-10		25		15
CA Droit		-10	20	20	20		-5		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes