


MEDVIE


Date du test: 15/08/2024 13:55:00
Durée: 3mn 00s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
GBANAMOU PAPA SEVERIN	
Date de naissance	01/01/2000
Age	24
Société	CHEC
ID	24081513531694991

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

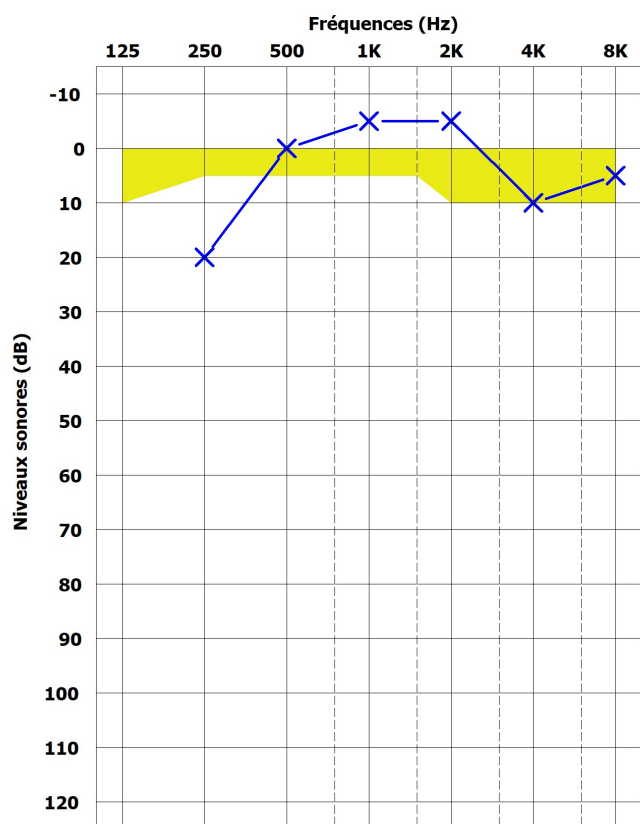

Oreille Gauche

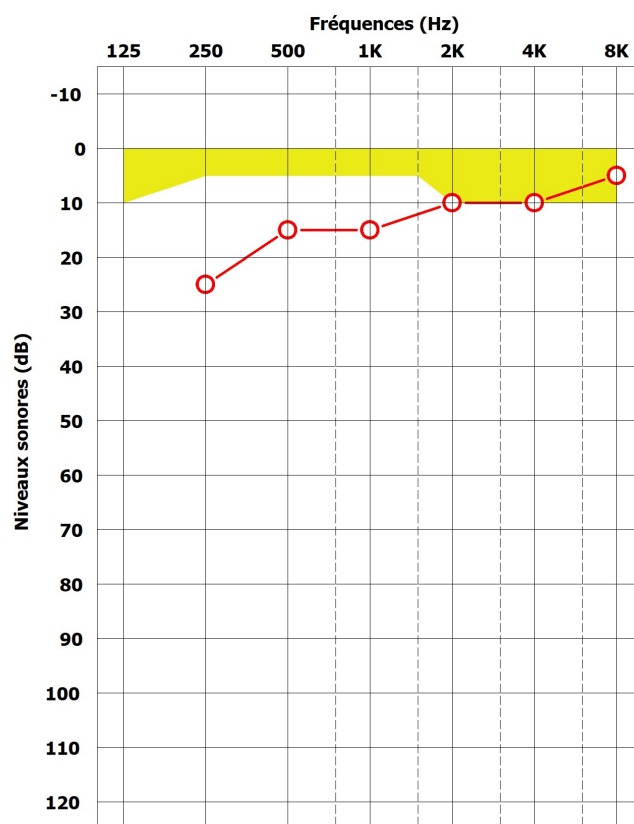

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	0		-5		-5		10		5
CA Droit		25	15		15		10		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	0,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes