

Données Patient


**CAMARA Mamoudou**

Date de naissance 03/04/1998  
Age 26  
Société CHEC  
ID 24090812022536395


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211  
Numéro de série: 2111EAT690093  
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 08/09/2024 12:06:28  
Durée: 8mn 01s  
Type test Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

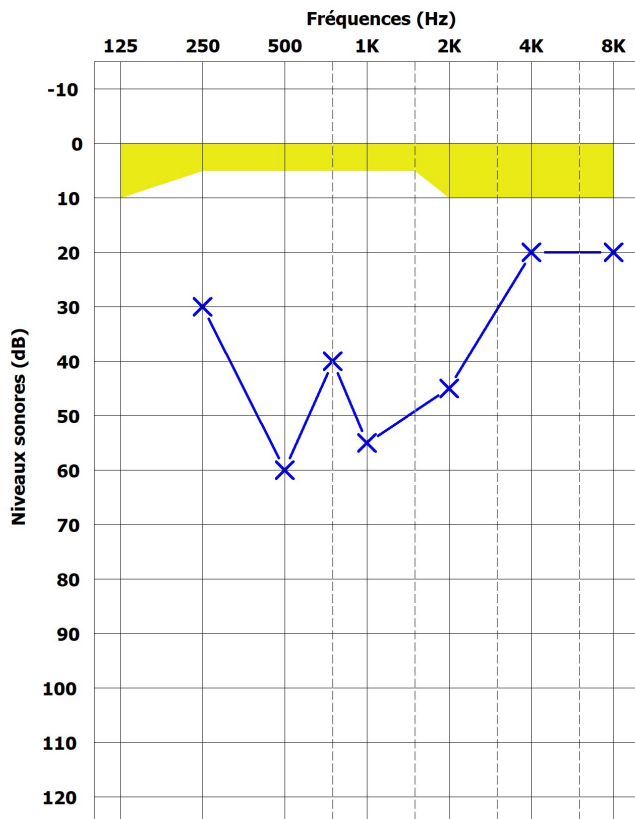

Oreille Gauche

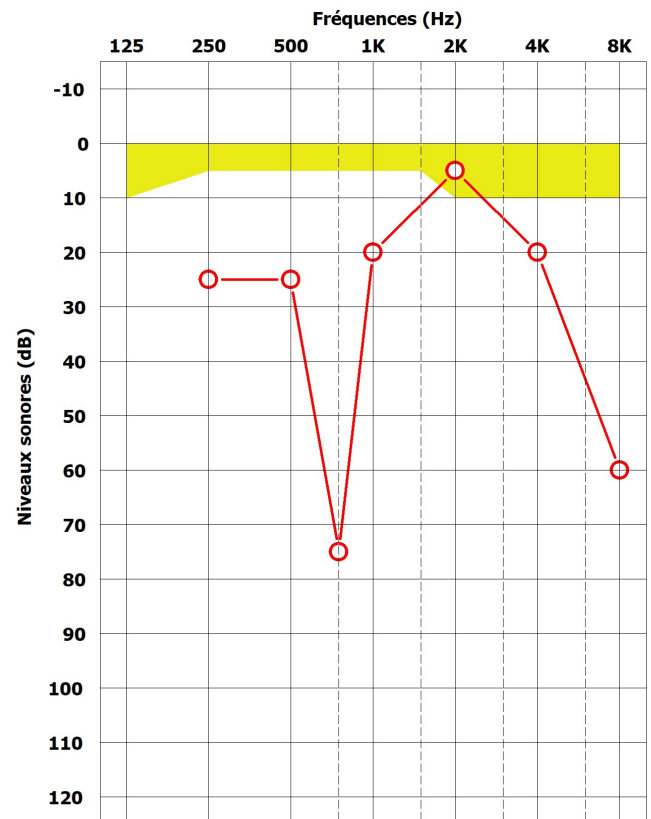

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 30  | 60  | 40  | 55 |     | 45 |    | 20 |    | 20 |
| CA Droit  |     | 25  | 25  | 75  | 20 |     | 5  |    | 20 |    | 60 |

Calcul de perte

|           | PAM     | IPA |
|-----------|---------|-----|
| CA Gauche | 45,0 dB | --- |
| CA Droit  | 17,5 dB | --- |

Notes