



Données Patient		TRAORE MOHAMED
Date de naissance	01/01/1998	
Age	26	
Société	CHEC	
ID	24070614404668654	

Date du test: 06/07/2024 14:42:45
Durée: 4mn 11s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

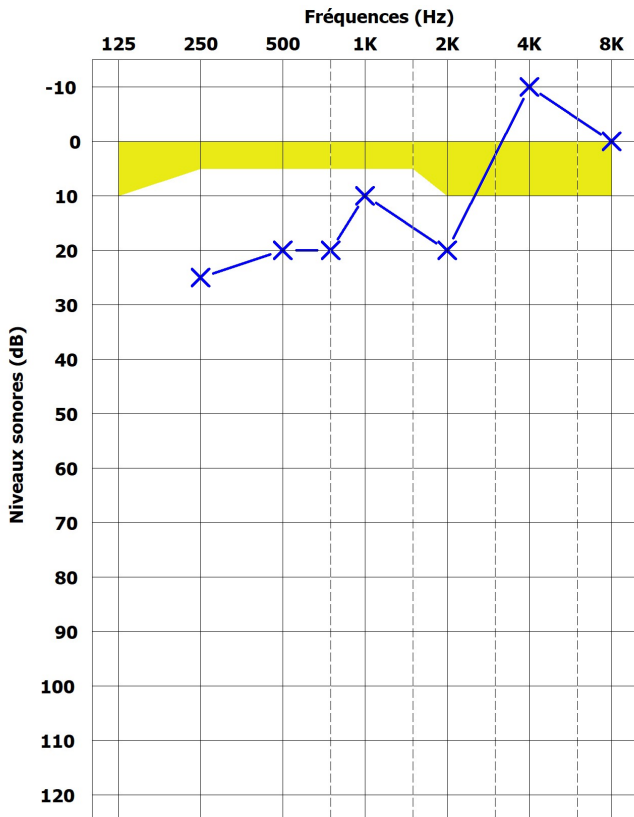

Oreille Gauche

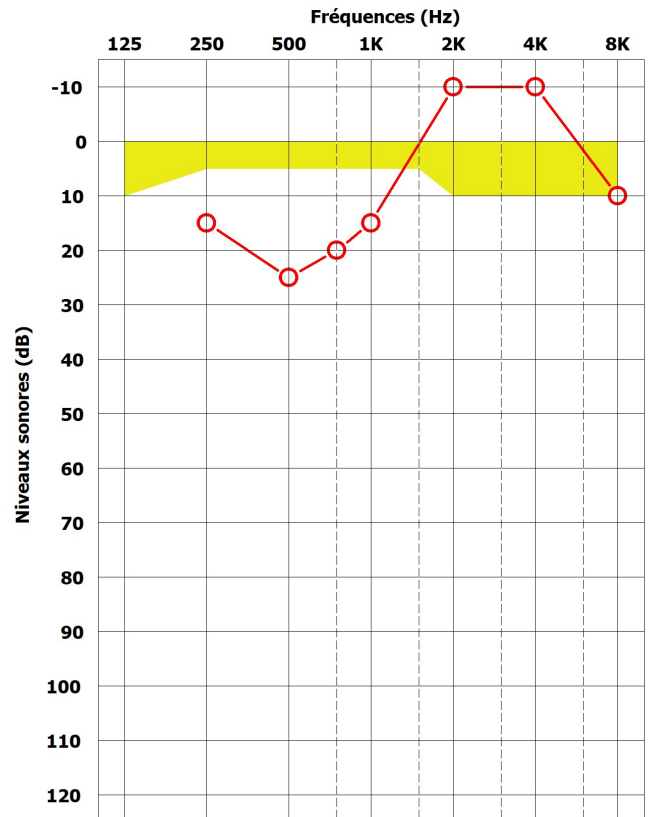

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	20	10		20		-10		0
CA Droit		15	25	20	15		-10		-10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes