


MEDVIE


Date du test: 09/08/2024 14:43:43  
Durée: 4mn 08s  
Type test Manuel  
Continu

| Données Patient   | CAMARA LAMINE     |
|-------------------|-------------------|
| Date de naissance | 02/05/1985        |
| Age               | 39                |
| Société           | CHEC              |
| ID                | 24080914405522425 |

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690093 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |

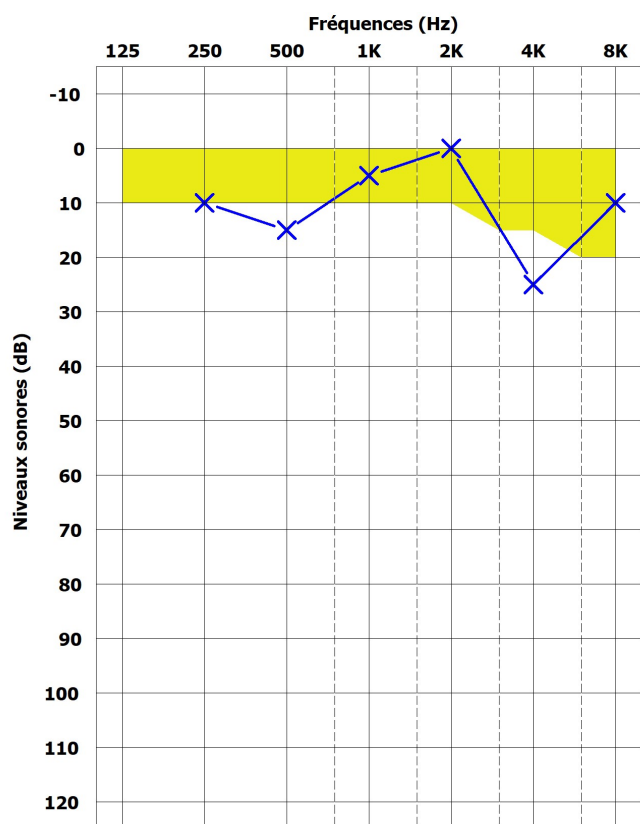

Oreille Gauche

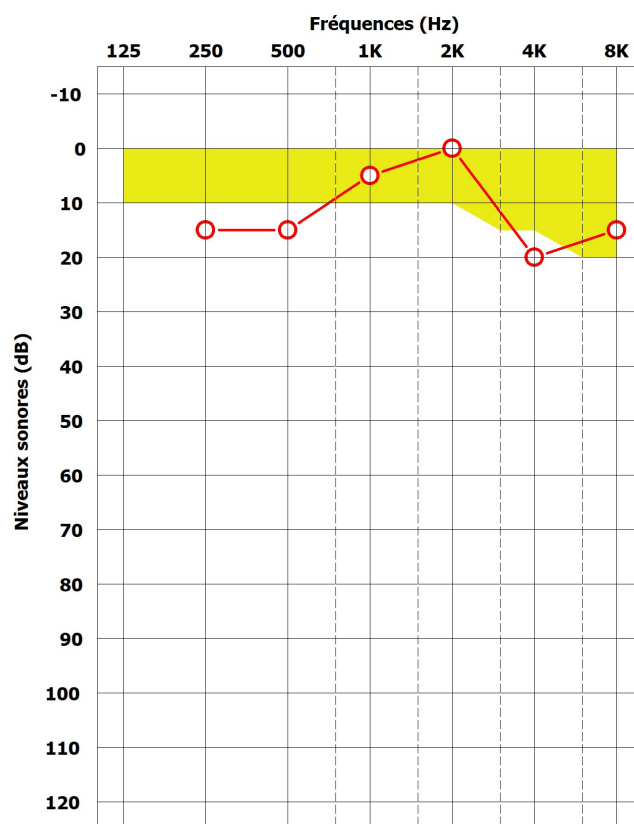

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 10  | 15  |     | 5  |     | 0  |    | 25 |    | 10 |
| CA Droit  |     | 15  | 15  |     | 5  |     | 0  |    | 20 |    | 15 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 11,3 dB | --- |
| CA Droit        | 10,0 dB | --- |

Notes