


MEDVIE


Date du test: 17/07/2024 15:41:33
Durée: 3mn 02s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	TRAORE YOUSOUF
Date de naissance	17/09/1975
Age	48
Société	CHEC
ID	24071715380492702

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

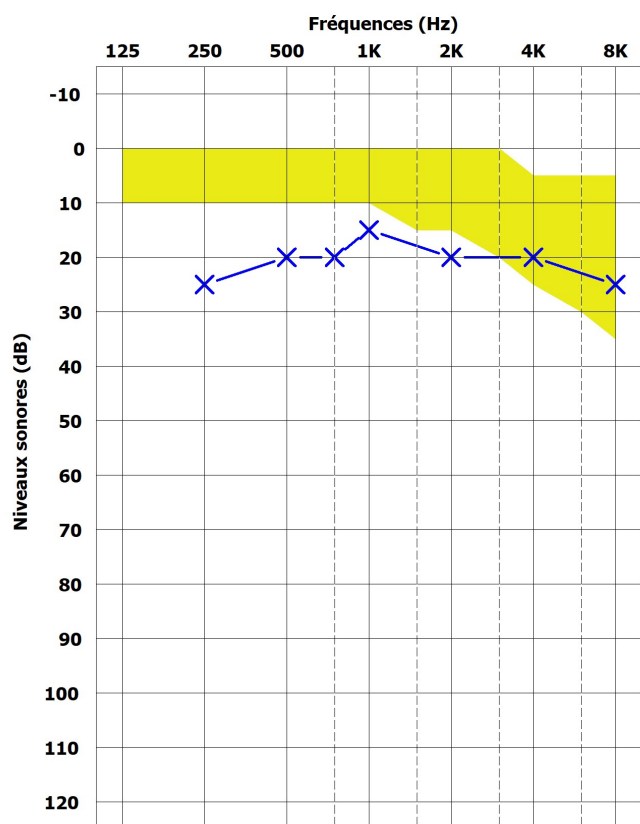

Oreille Gauche

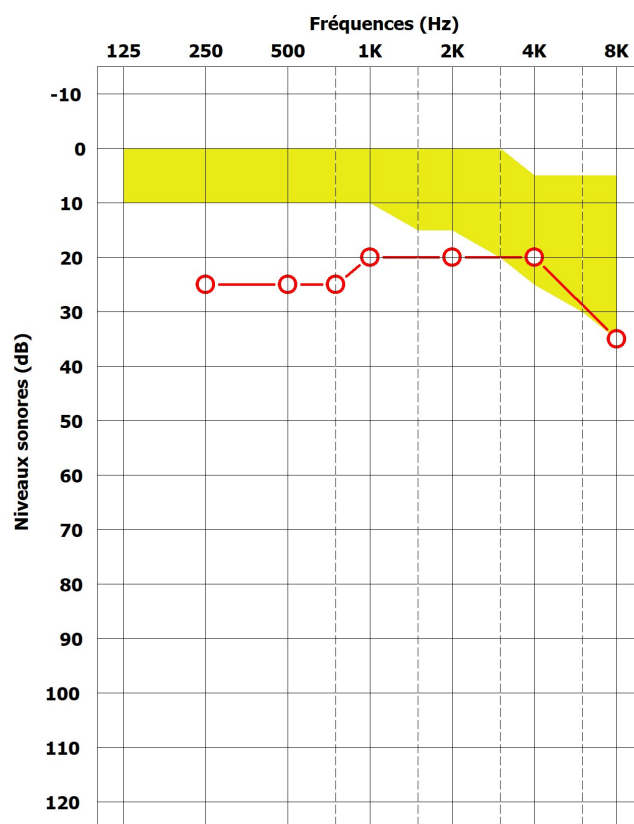

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	20	15		20		20		25
CA Droit		25	25	25	20		20		20		35

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes