

MEDVIE


Date du test: 08/09/2024 13:23:27

Durée: 5mn 24s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>CAMARA ABOUBACAR</b> |                   |
| Date de naissance       | 02/02/1993        |
| Age                     | 31                |
| Société                 | CHEC              |
| ID                      | 24090813183964976 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

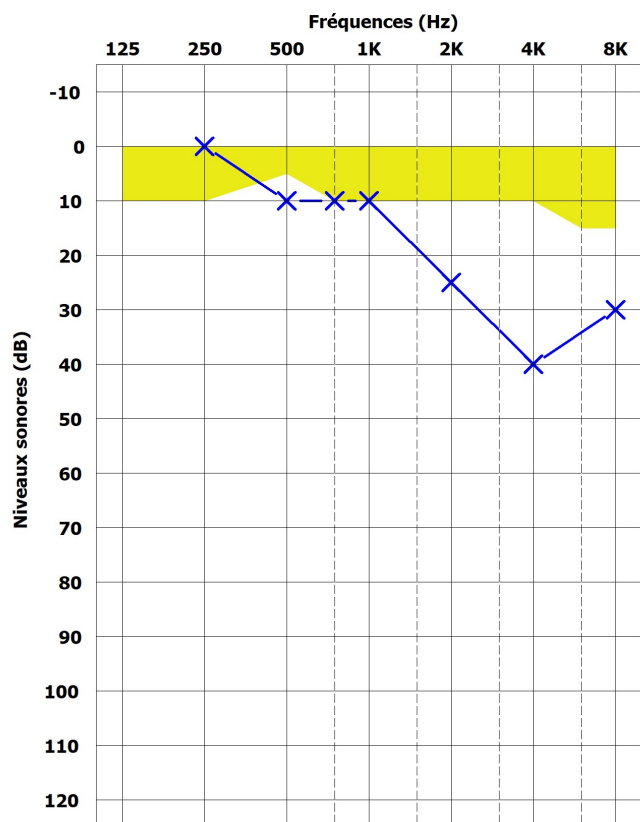

Oreille Gauche

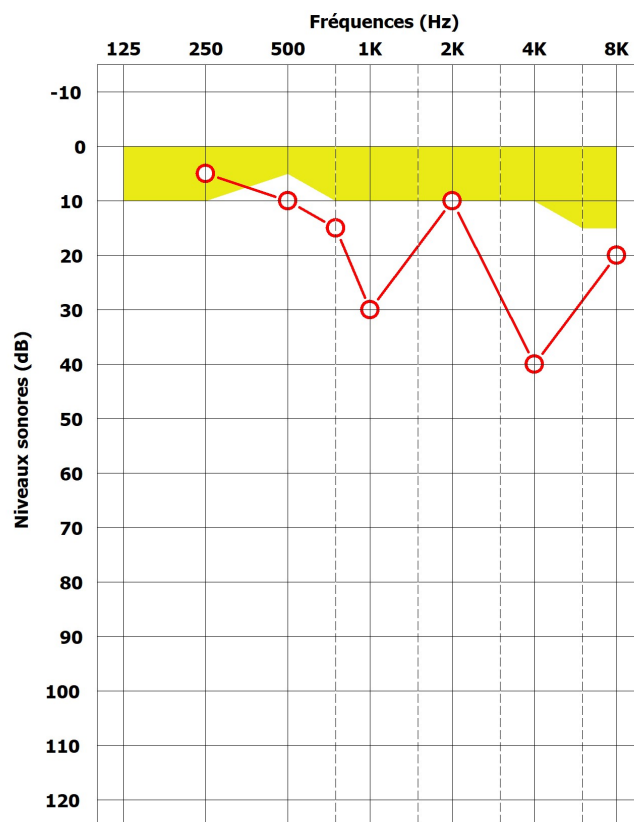

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 0   | 10  | 10  | 10 |     | 25 |    | 40 |    | 30 |
| CA Droit  |     | 5   | 10  | 15  | 30 |     | 10 |    | 40 |    | 20 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 21,3 dB | --- |
| CA Droit        | 22,5 dB | --- |

Notes