


MEDVIE

Date du test: 06/09/2024 14:01:16

Durée: 5mn 46s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

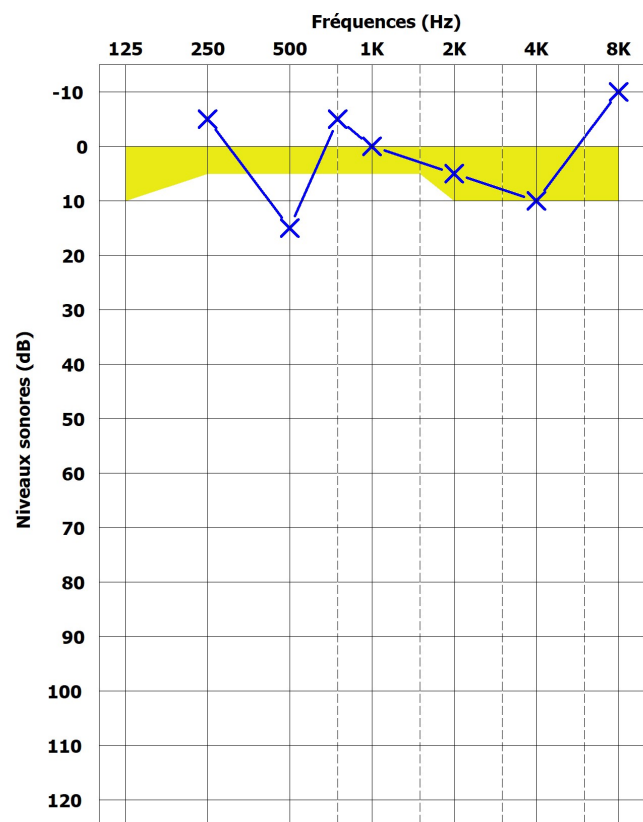

Oreille Gauche

Données Patient	
DOUMBOUYA ALMAMY I ΔYF	
Date de naissance	25/05/1999
Age	25
Société	CHEC
ID	24090613570197708

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

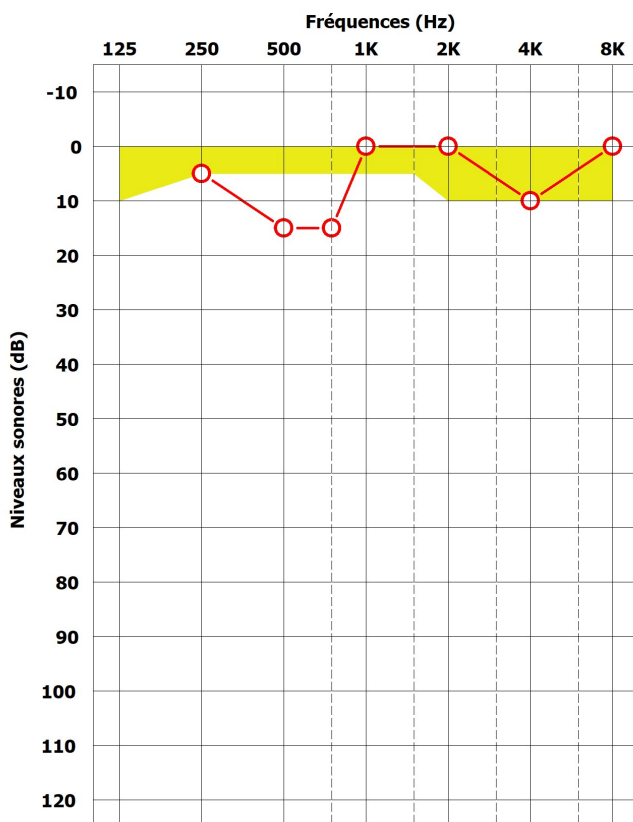

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	15	-5	0		5		10		-10
CA Droit		5	15	15	0		0		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes