



| Données Patient   |                   | SOUARE AMADOU |
|-------------------|-------------------|---------------|
| Date de naissance | 01/01/1990        |               |
| Age               | 34                |               |
| Société           | CHEC              |               |
| ID                | 24121113292242626 |               |

Date du test: 11/12/2024 13:33:35  
Durée: 4mn 27s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

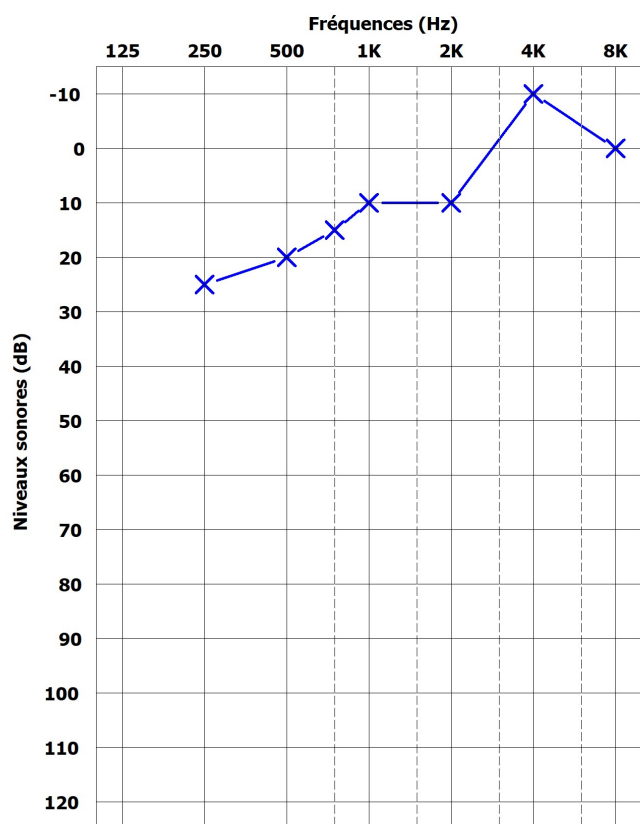

Oreille Gauche

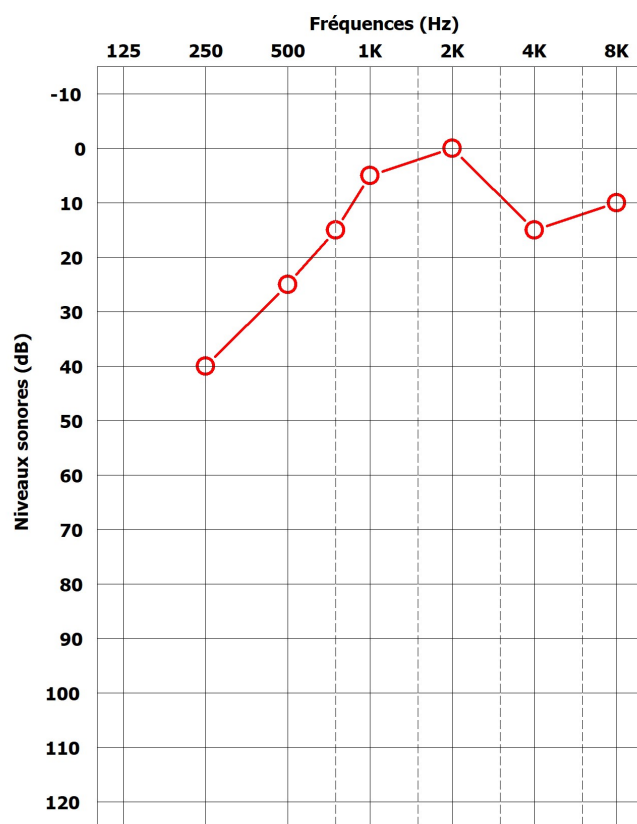

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k  | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|----|----|
| CA Gauche |     | 25  | 20  | 15  | 10 |     | 10 |    | -10 |    | 0  |
| CA Droit  |     | 40  | 25  | 15  | 5  |     | 0  |    | 15  |    | 10 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 7,5 dB  | --- |
| CA Droit        | 11,3 dB | --- |

Notes