

MED VIE


Date du test: 19/06/2024 16:22:34

Durée: 3mn 25s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO ISSIAGA	
Date de naissance	01/01/1987
Age	37
Société	CHEC
ID	24061916201876210

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

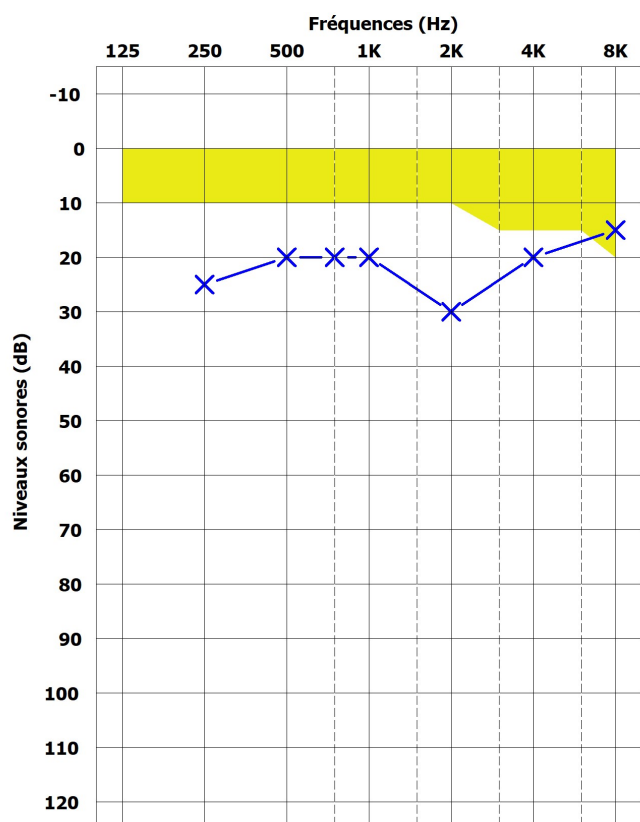

Oreille Gauche

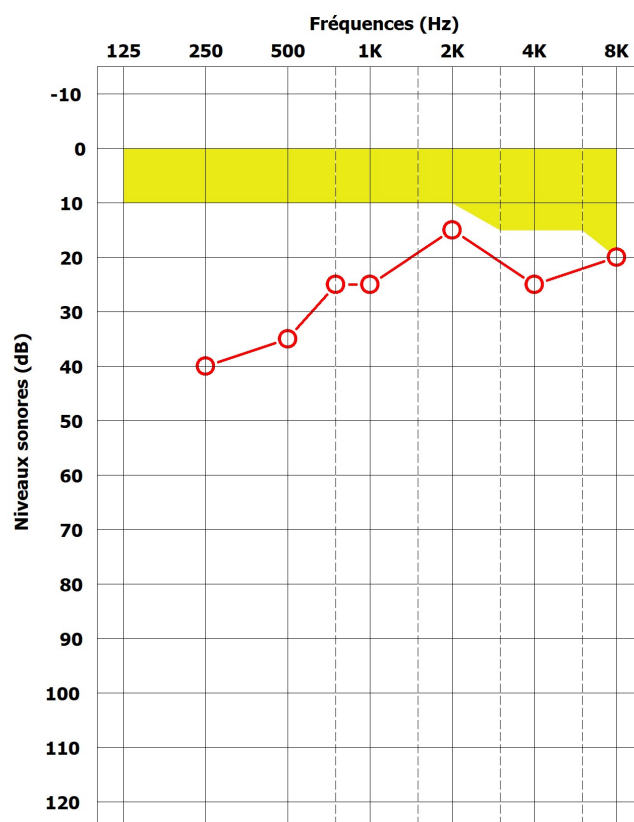

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	20	20		30		20		15
CA Droit		40	35	25	25		15		25		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	25,0 dB	---

Notes