


MEDVIE


Date du test: 15/08/2024 14:00:49
Durée: 2mn 28s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
SOUMAH IBRAHIMA	
Date de naissance	01/01/2003
Age	21
Société	CHEC
ID	24081513590675553

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

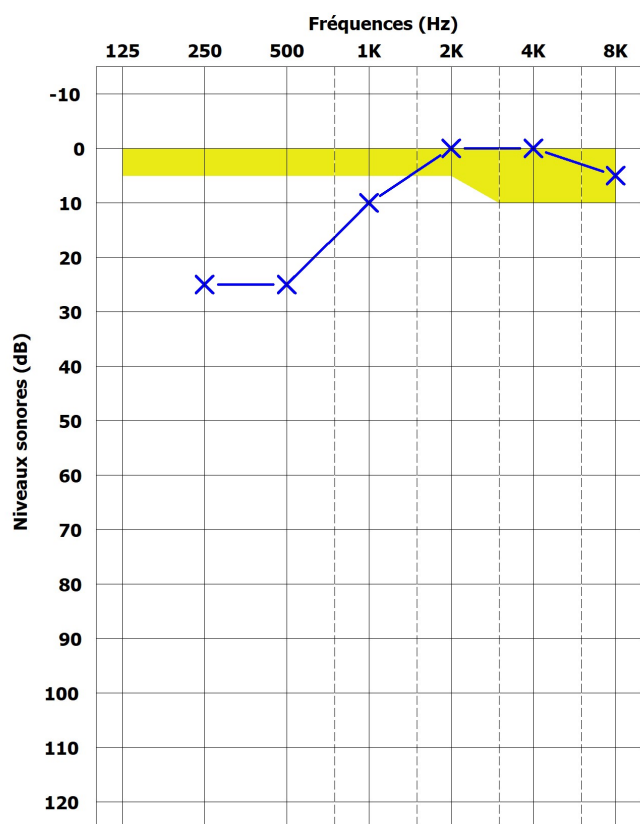

Oreille Gauche

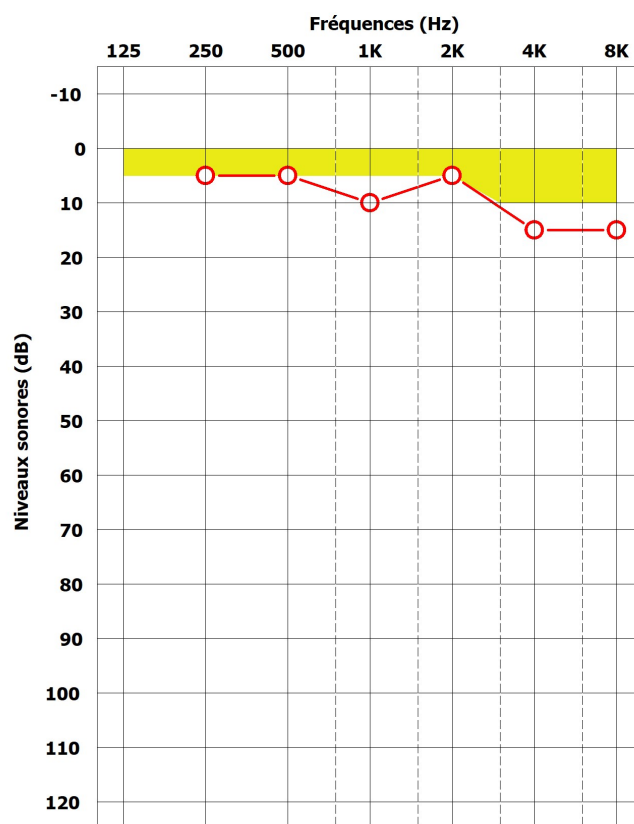

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25		10		0		0		5
CA Droit		5	5		10		5		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes