



| Données Patient       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>CAMARA MOHAMED</b> |                   |
| Date de naissance     | 03/06/1997        |
| Age                   | 27                |
| Société               | CHEC              |
| ID                    | 24092614140913335 |

Date du test: 26/09/2024 14:15:54  
Durée: 6mn 50s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

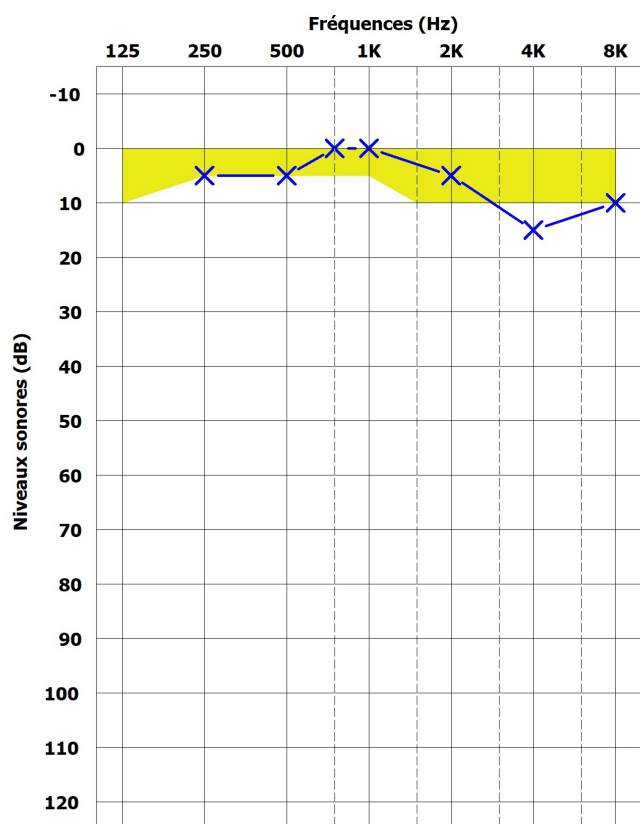

Oreille Gauche

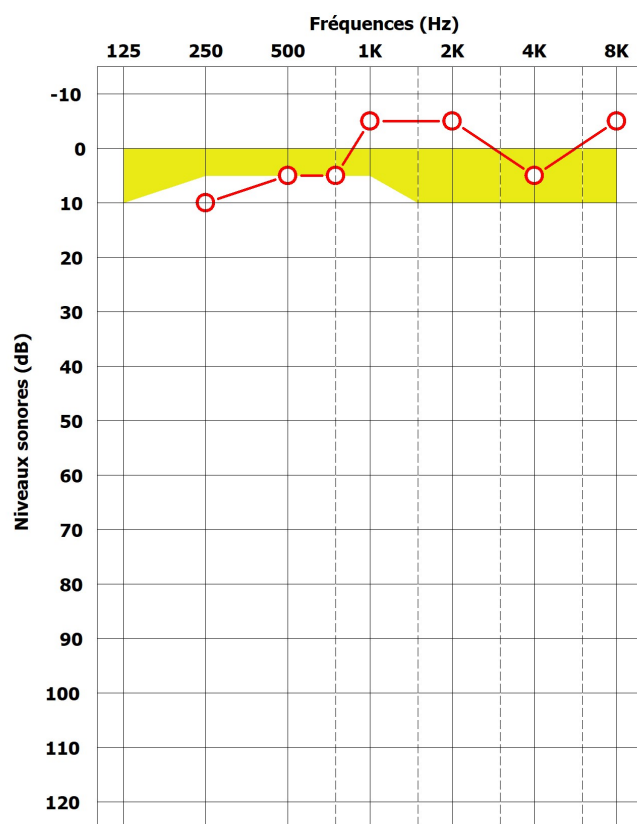

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 5   | 5   | 0   | 0  |     | 5  |    | 15 |    | 10 |
| CA Droit  |     | 10  | 5   | 5   | -5 |     | -5 |    | 5  |    | -5 |

| Calcul de perte | PAM    | IPA |
|-----------------|--------|-----|
| CA Gauche       | 6,3 dB | --- |
| CA Droit        | 0,0 dB | --- |

Notes