

MEDVIE


Date du test: 17/07/2024 16:01:52

Durée: 6mn 04s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SOUMAH SEYDOUBA	
Date de naissance	01/01/1974
Age	50
Société	CHEC
ID	24071716000411661

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

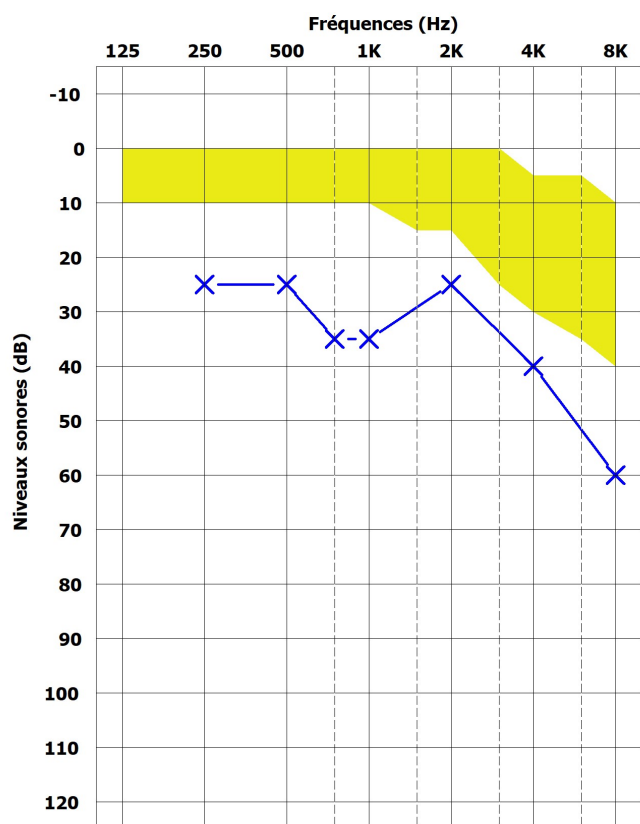

Oreille Gauche

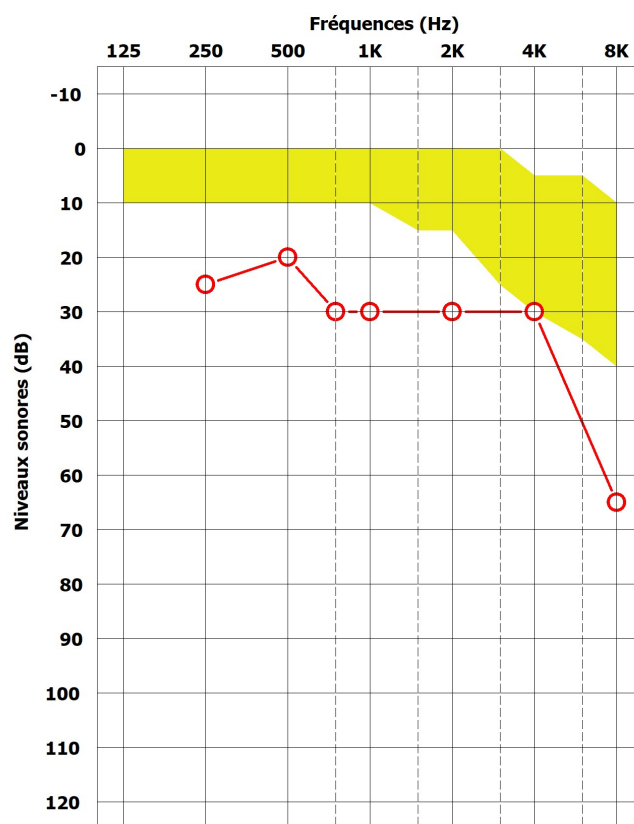

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	35	35		25		40		60
CA Droit		25	20	30	30		30		30		65

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	31,3 dB	---
CA Droit	27,5 dB	---

Notes