


MEDVIE

Date du test: 08/09/2024 14:16:09

Durée: 7mn 23s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

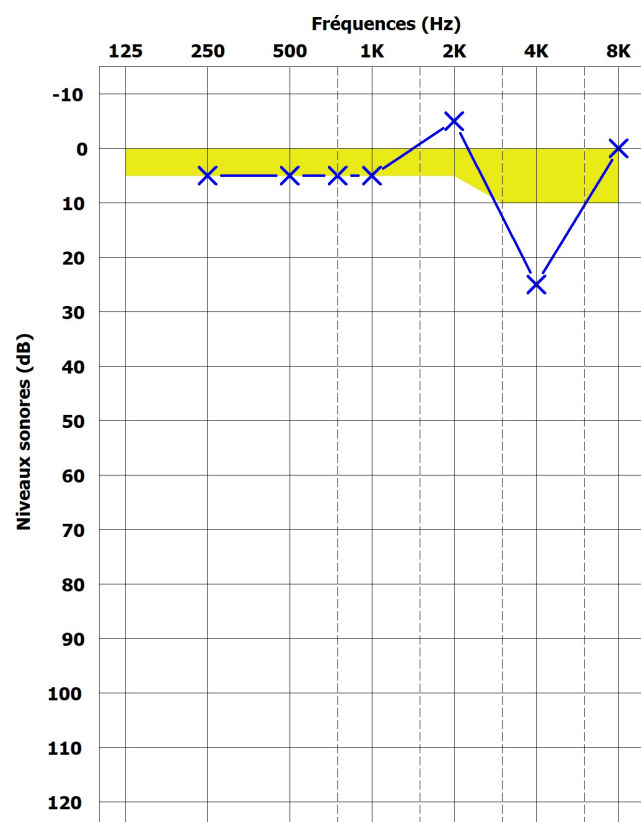

Oreille Gauche

Données Patient	
BANGOURA FODE MOISSA	
Date de naissance	02/02/2003
Age	21
Société	CHEC
ID	24090814090956812

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

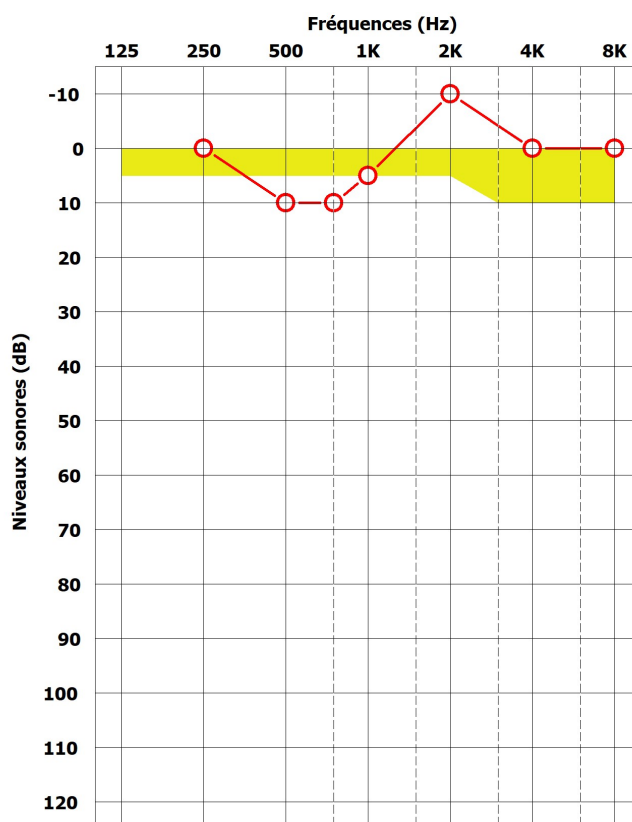

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	5	5	5		-5		25		0
CA Droit		0	10	10	5		-10		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	1,3 dB	---

Notes