



| Données Patient   | PRICEMOU NYANKOYE |
|-------------------|-------------------|
| Date de naissance | 12/10/1990        |
| Age               | 33                |
| Société           | CHEC              |
| ID                | 24070614065209928 |

Date du test: 06/07/2024 14:11:05  
 Durée: 7mn 29s  
 Type test: Auto  
 Normal  
 Continu  
 Scén. Standard

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690092 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |

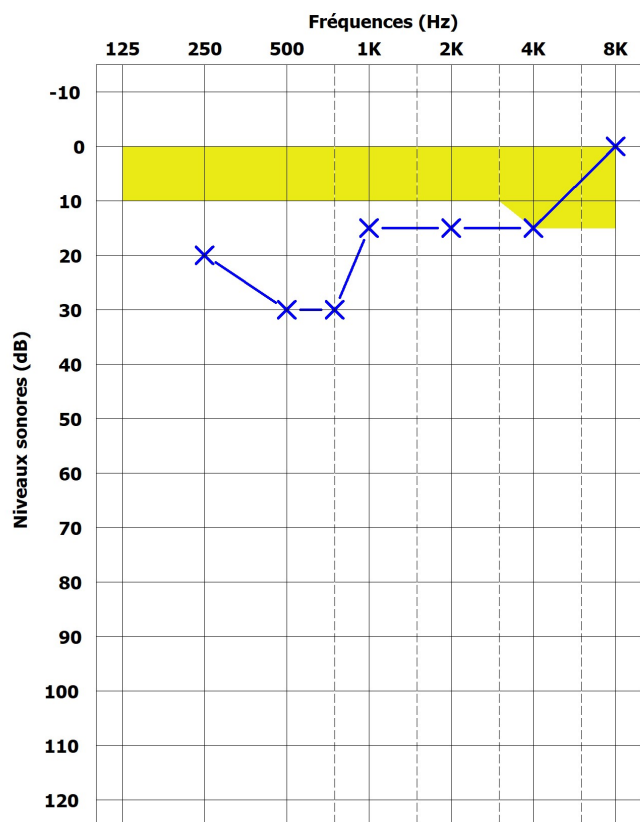

Oreille Gauche

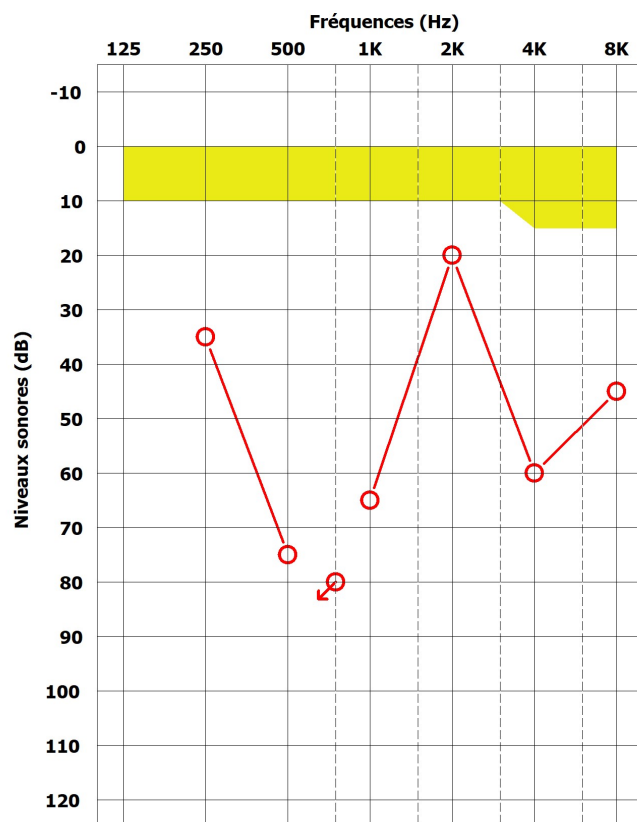

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750  | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|------|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 20  | 30  | 30   | 15 |     | 15 |    | 15 |    | 0  |
| CA Droit  |     | 35  | 75  | (80) | 65 |     | 20 |    | 60 |    | 45 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 18,8 dB | --- |
| CA Droit        | 55,0 dB | --- |

Notes