

MED VIE

Date du test: 19/06/2024 14:22:12

Durée: 4mn 50s

 Type test
 Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Données Patient

SOW IBRAHIMA

Date de naissance 01/01/1987

Age 37

Société CHEC


ID 24061914200337572

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

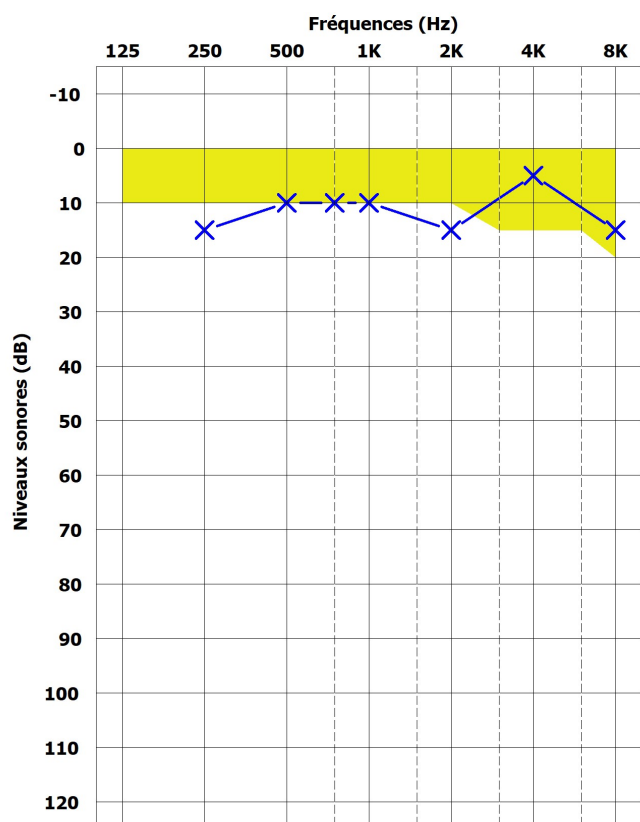

Oreille Gauche

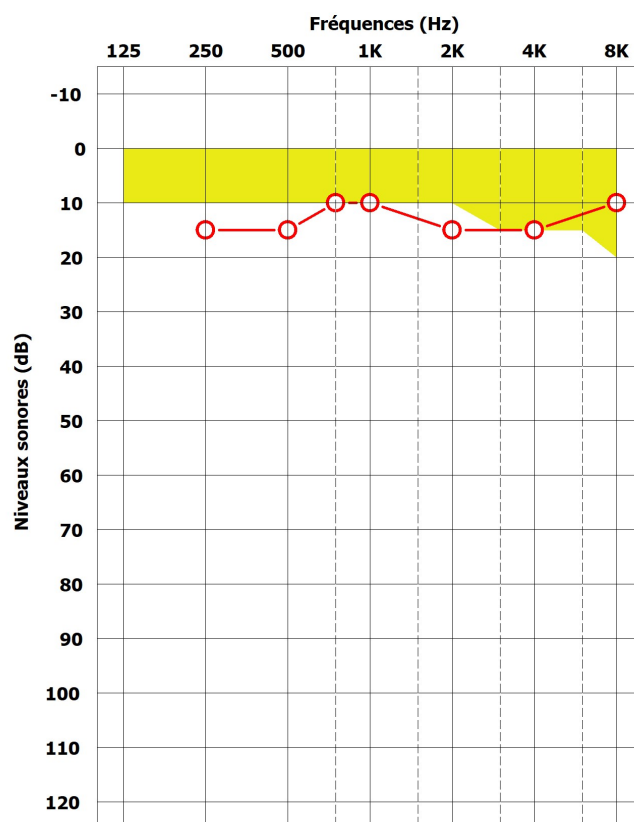

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	10	10	10		15		5		15
CA Droit		15	15	10	10		15		15		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes