

MEDVIE


Date du test: 17/07/2024 13:41:46

Durée: 4mn 19s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		TRAORE SEKOU
Date de naissance	18/12/1992	
Age	31	
Société	CHEC	
ID	24071713392420058	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

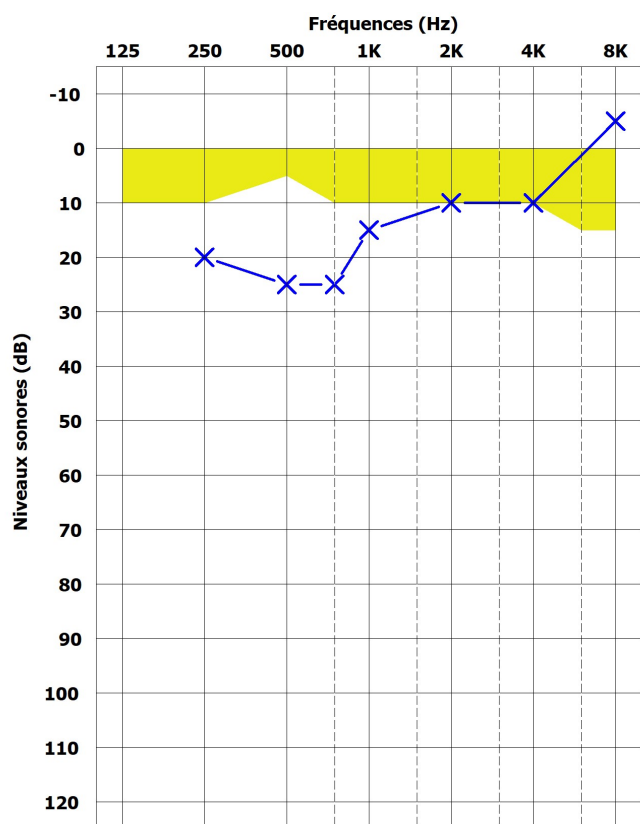

Oreille Gauche

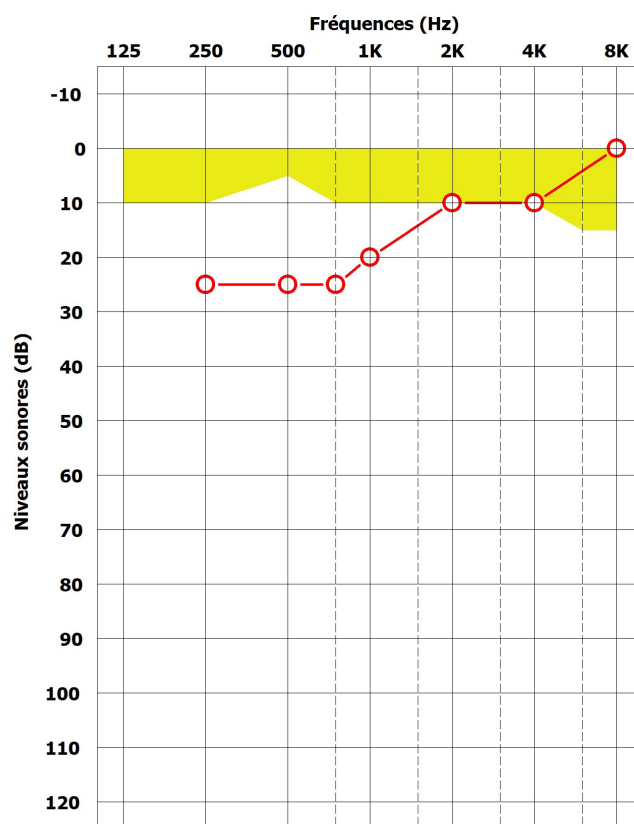

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	25	15		10		10		-5
CA Droit		25	25	25	20		10		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes