

Données Patient

SOUMAH ALYA

Date de naissance

01/01/1990

Age

34

Société

CHEC

ID

24092618080233422

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :


30/11/2021

Date du test: 26/09/2024 18:09:32


Durée: 4mn 02s

Type test

Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

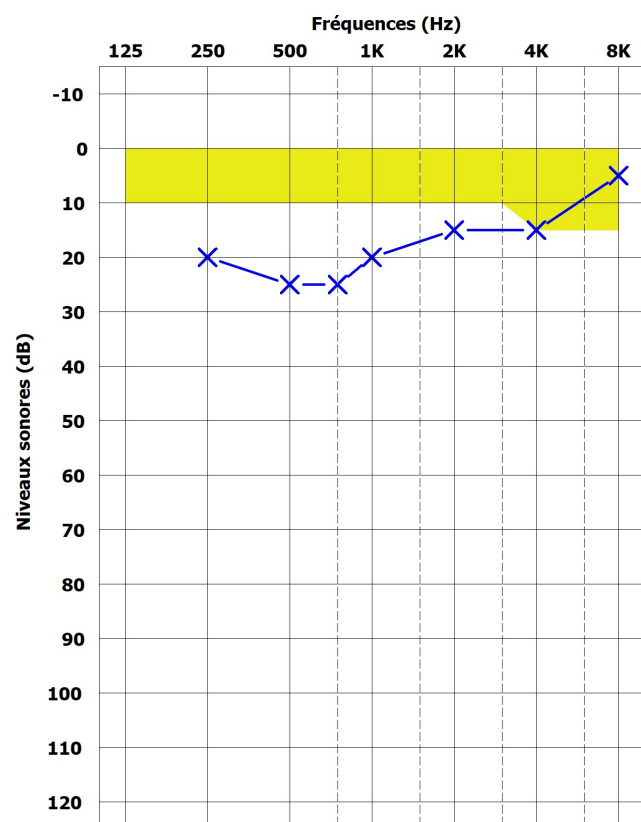

Oreille Gauche

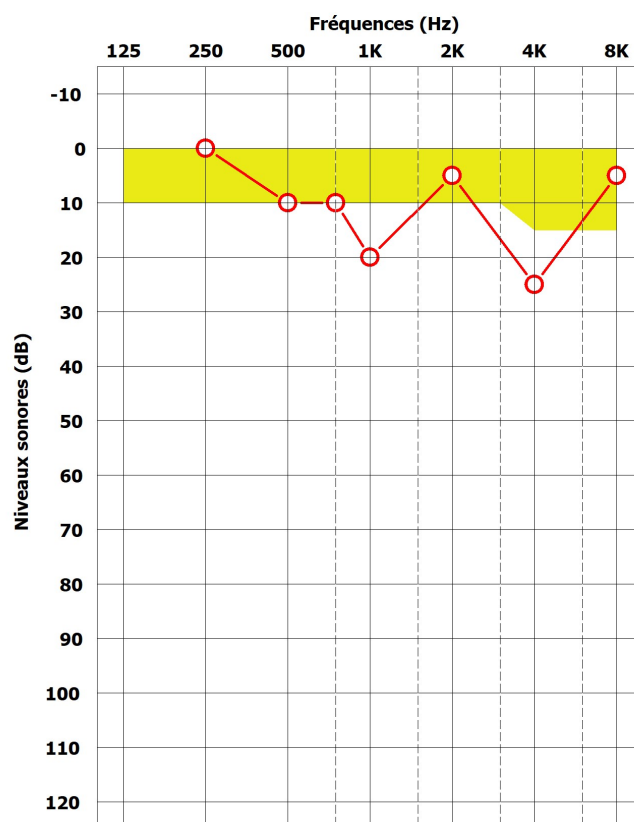

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	25	20		15		15		5
CA Droit		0	10	10	20		5		25		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes