



Données Patient		SOUMAH MOHAME
Date de naissance	01/01/2005	
Age	19	
Société	CHEC	
ID	24070514092400680	

Date du test: 05/07/2024 14:14:54
Durée: 9mn 14s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

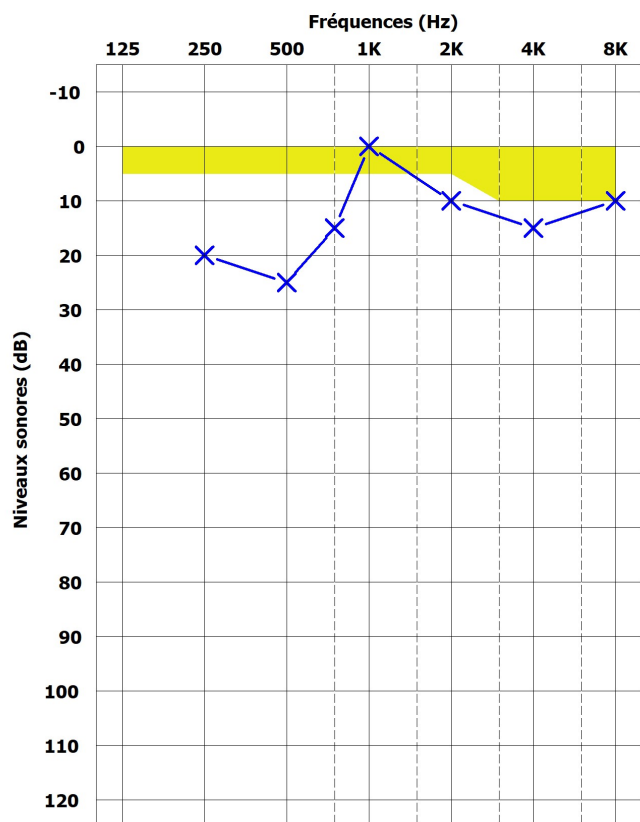

Oreille Gauche

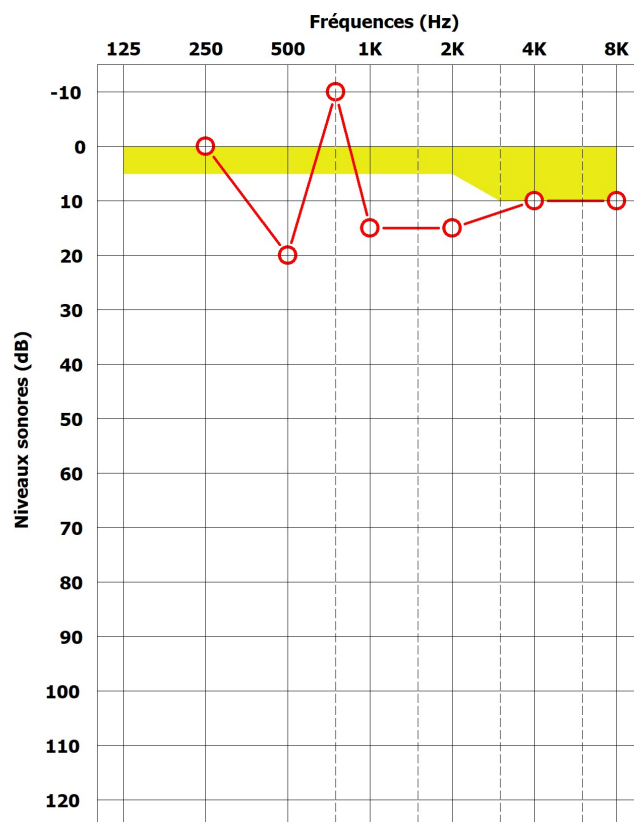

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	15	0		10		15		10
CA Droit		0	20	-10	15		15		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes