


MEDVIE


Date du test: 15/08/2024 16:21:14
Durée: 4mn 04s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	YOULA MUHAMED D. IFNARA
Date de naissance	01/06/2000
Age	24
Société	CHEC
ID	24081516064360130

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

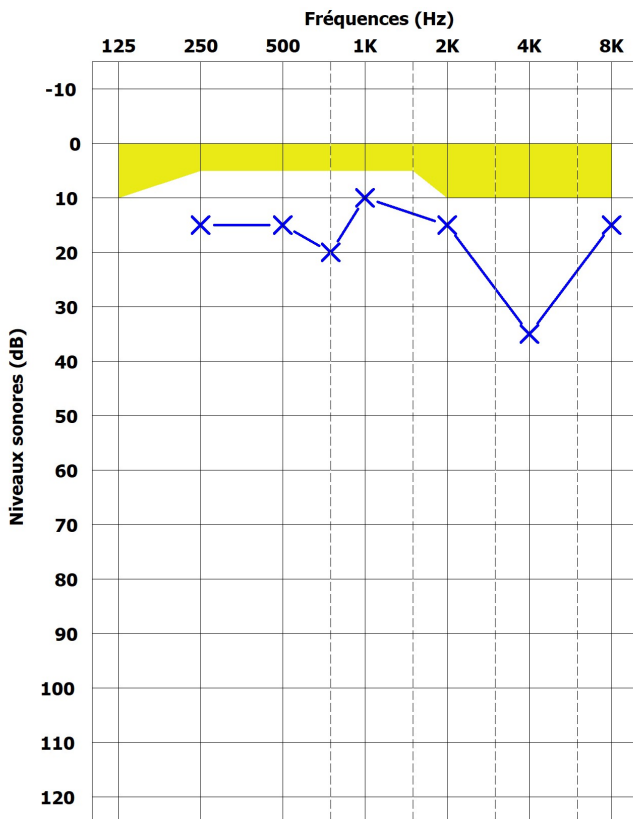

Oreille Gauche

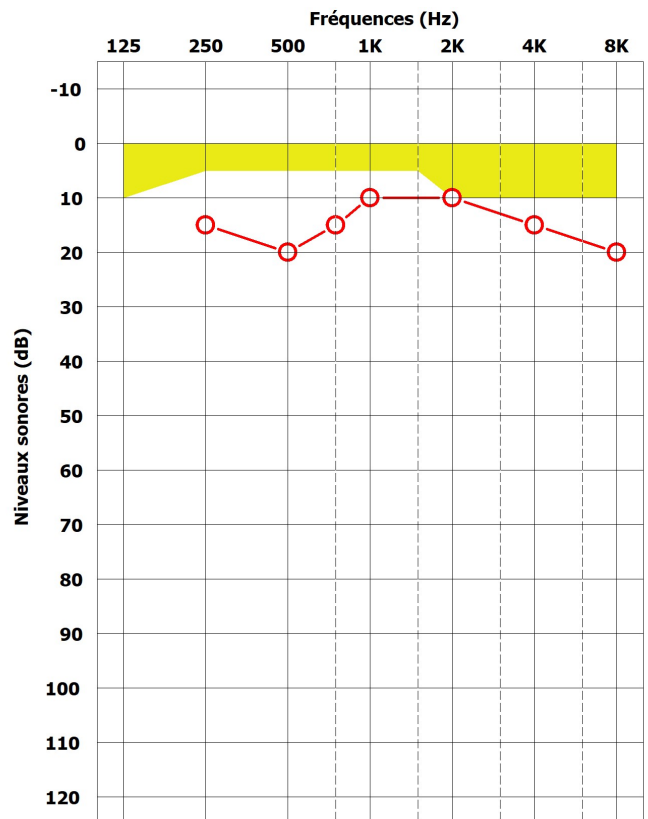

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	20	10		15		35		15
CA Droit		15	20	15	10		10		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes