


MEDVIE


Date du test: 07/08/2024 12:13:29
Durée: 4mn 06s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	DIALLO FATOUMATA RINTA
Date de naissance	11/05/2003
Age	21
Société	CHEC
ID	24080711583208885

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

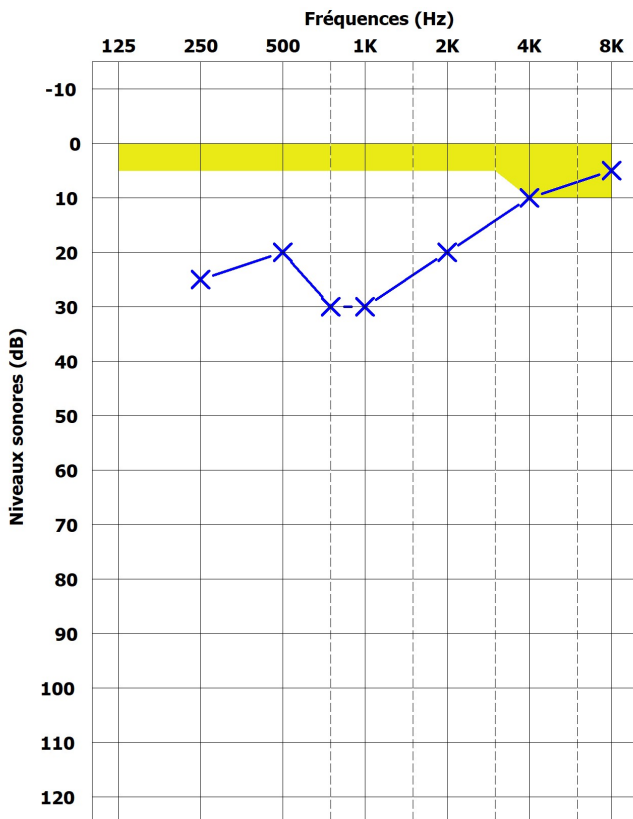

Oreille Gauche

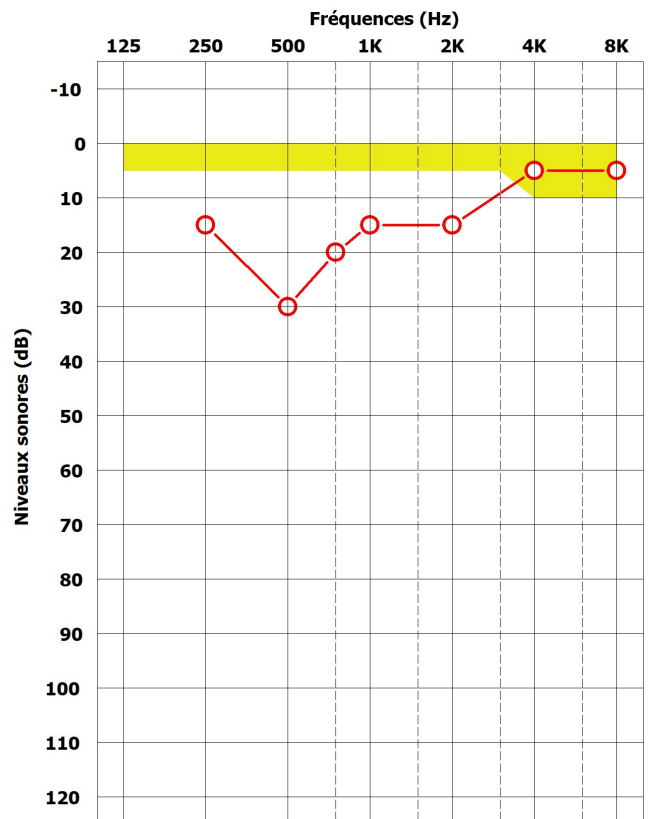

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	30	30		20		10		5
CA Droit		15	30	20	15		15		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes