


MEDVIE


Date du test: 07/08/2024 13:16:13
Durée: 3mn 59s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO YERO BAILO	
Date de naissance	01/01/1993
Age	31
Société	CHEC
ID	24080713111614425

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

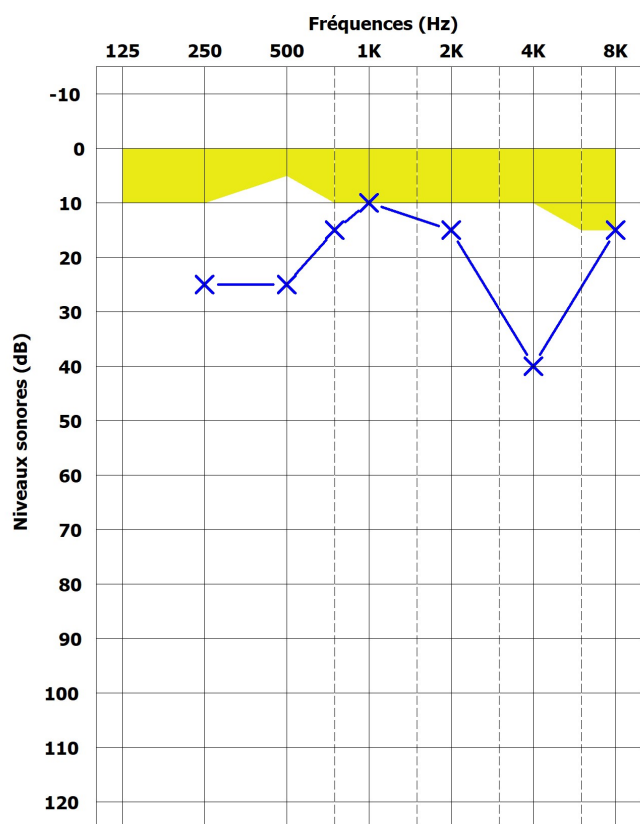

Oreille Gauche

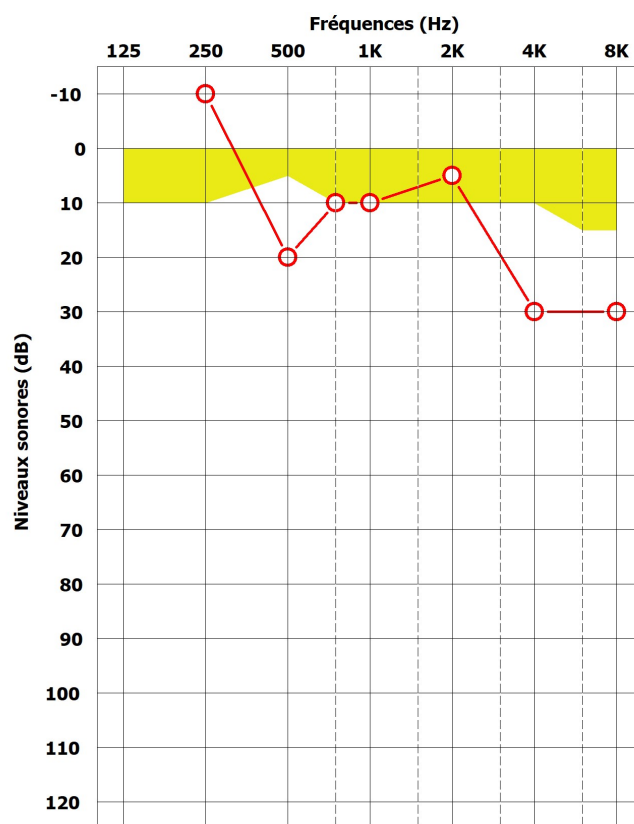

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	15	10		15		40		15
CA Droit		-10	20	10	10		5		30		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes