


MEDVIE


Date du test: 31/08/2024 16:30:21
Durée: 5mn 00s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA MOHAMED	
Date de naissance	14/05/2003
Age	21
Société	CHEC
ID	24083116264958294

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

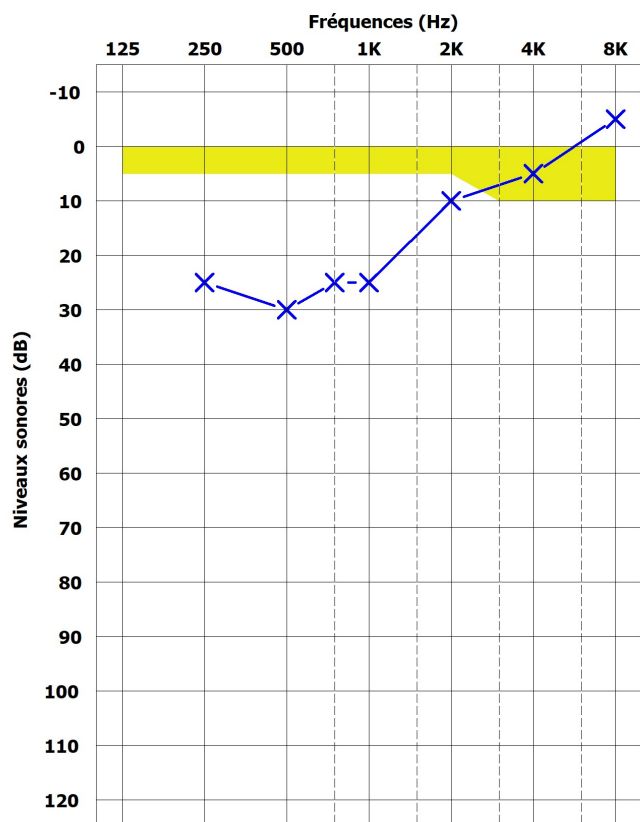

Oreille Gauche

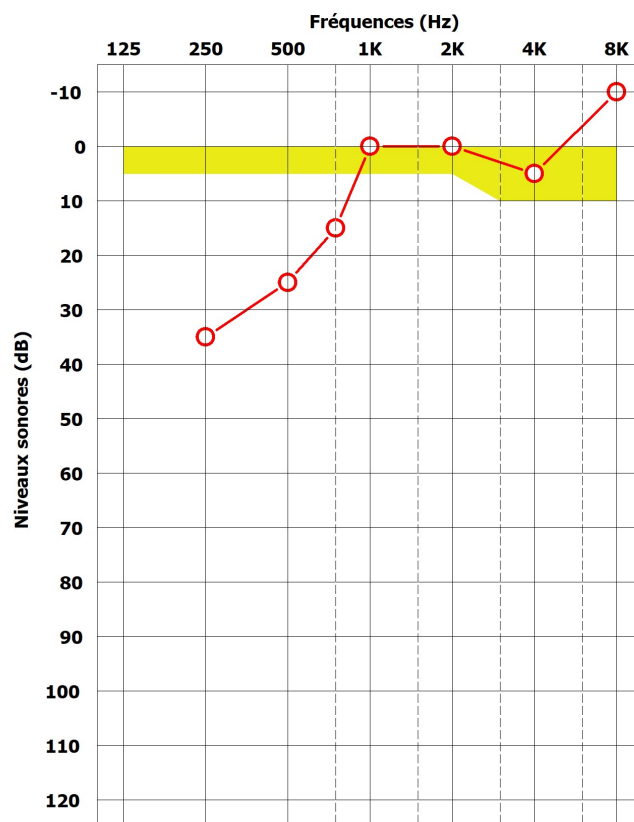

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	25	25		10		5		-5
CA Droit		35	25	15	0		0		5		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes