



Données Patient	
SOUHAM MOHAMED I AMINE	
Date de naissance	18/02/1983
Age	41
Société	CHEC
ID	24090711125353312

Date du test: 07/09/2024 11:10:34
Durée: 6mn 10s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

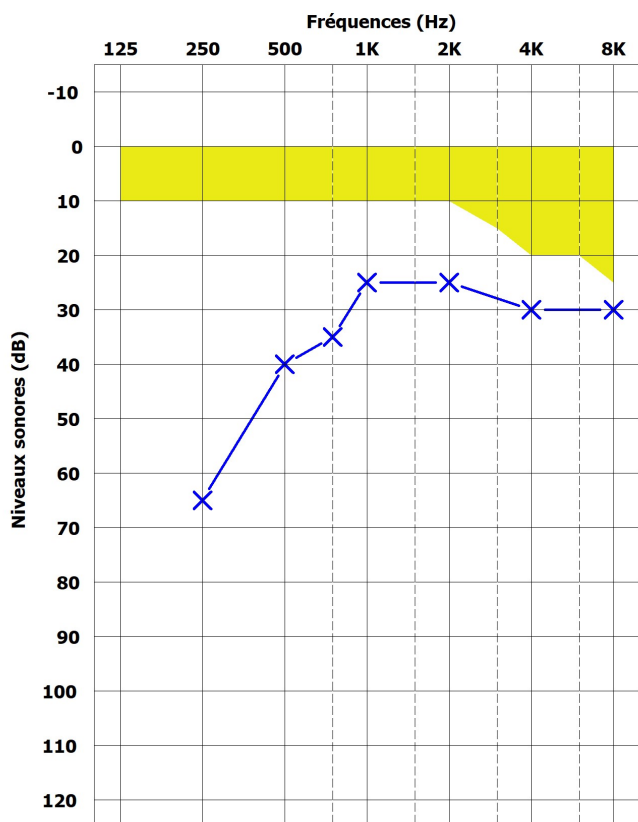

Oreille Gauche

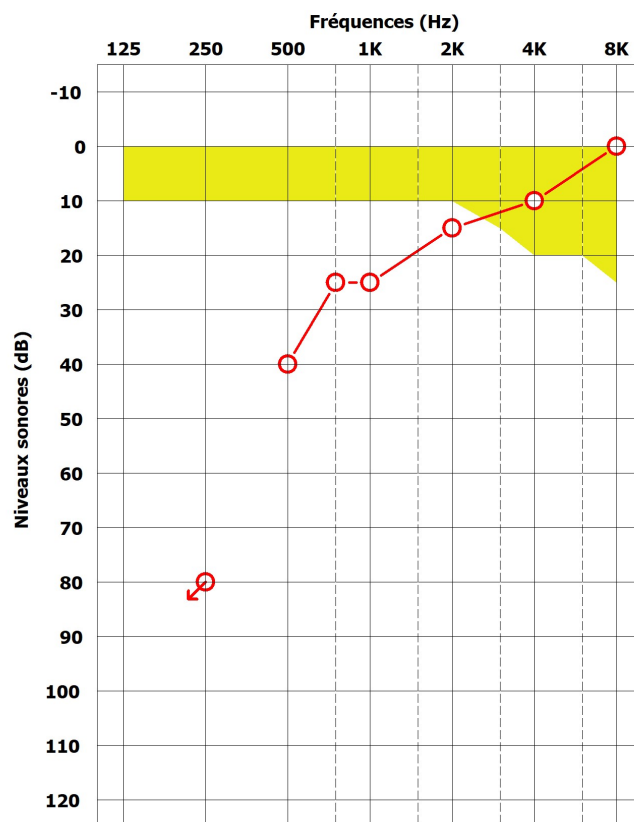

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		65	40	35	25		25		30		30
CA Droit		(80)	40	25	25		15		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	30,0 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes