

MEDVIE


Date du test: 15/07/2024 15:59:44

Durée: 5mn 37s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BANGOURA YAKOUBA	
Date de naissance	01/01/1996
Age	28
Société	CHEC
ID	24071515544140413

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

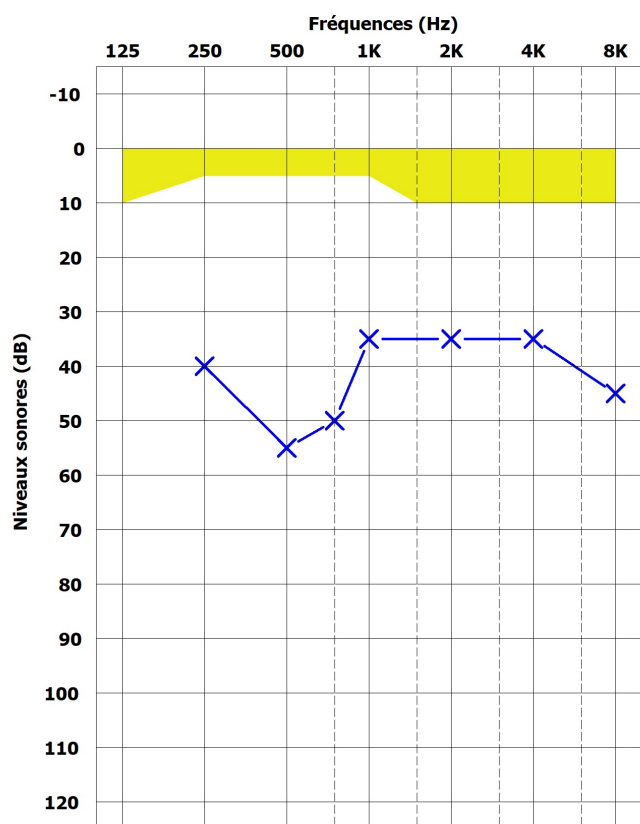

Oreille Gauche

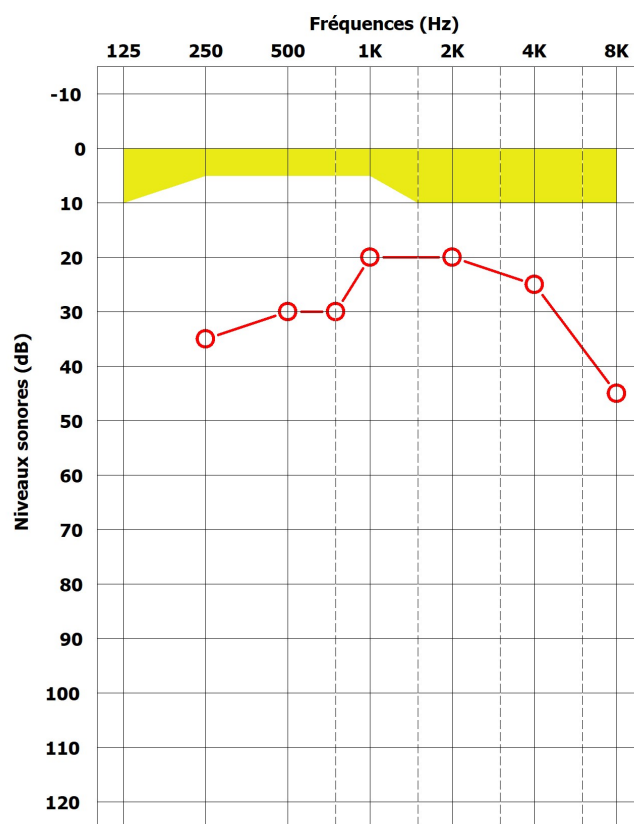

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		40	55	50	35		35		35		45
CA Droit		35	30	30	20		20		25		45

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	40,0 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes