


MEDVIE


Date du test: 06/09/2024 13:55:04
Durée: 4mn 25s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SYLLA Mohamed
Date de naissance	01/01/1976
Age	48
Société	CHEC
ID	24090613503872362

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

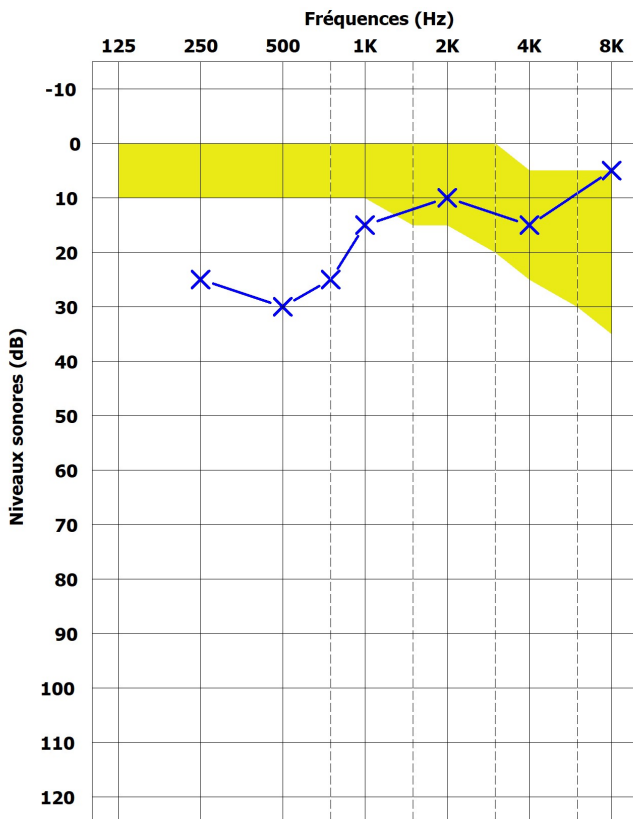

Oreille Gauche

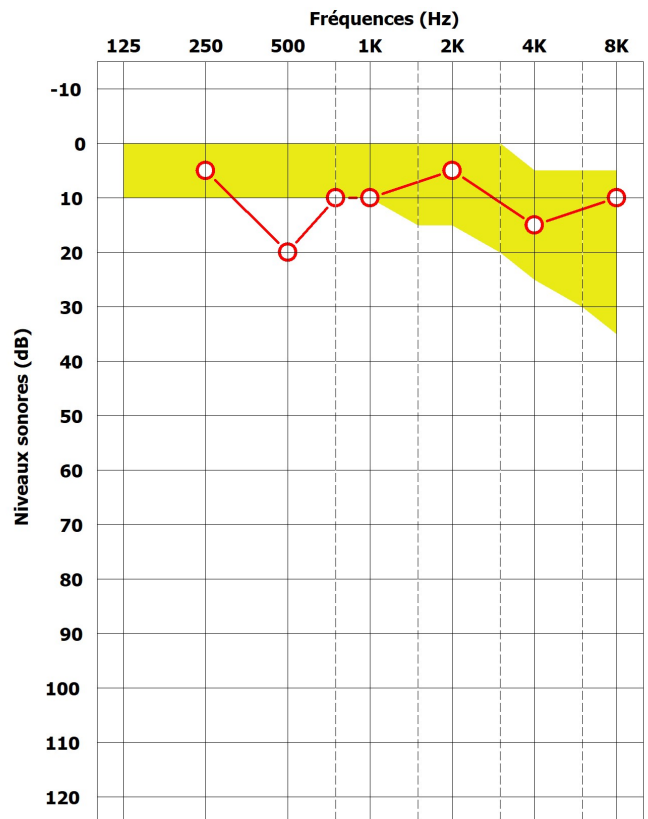

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	25	15		10		15		5
CA Droit		5	20	10	10		5		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes