


MEDVIE


Date du test: 14/08/2024 14:16:05

Durée: 4mn 26s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

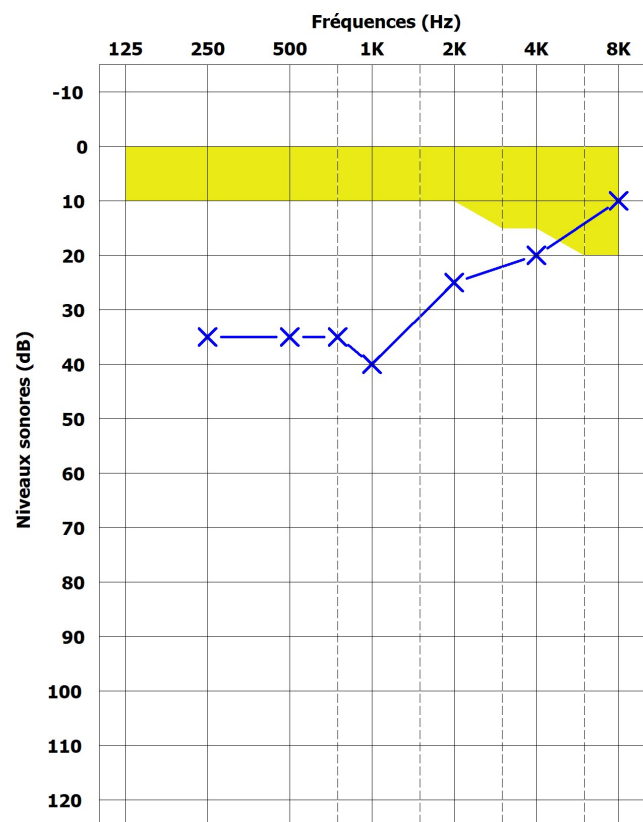

Oreille Gauche

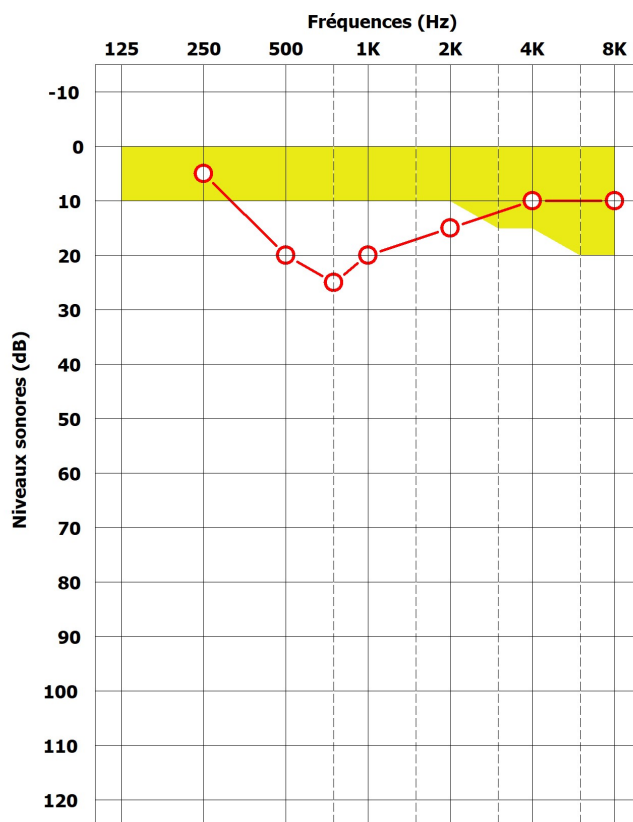

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	35	35	40		25		20		10
CA Droit		5	20	25	20		15		10		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	30,0 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes

Données Patient

SYLLA Morlaye

Date de naissance

28/09/1984

Age

39

Société

chec

ID

24081414132287083

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021