

Données Patient


CAMARA SEKOU

Date de naissance 01/01/1988
Age 36
Société CHEC
ID 24091112320736052


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 11/09/2024 12:50:51
Durée: 6mn 25s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

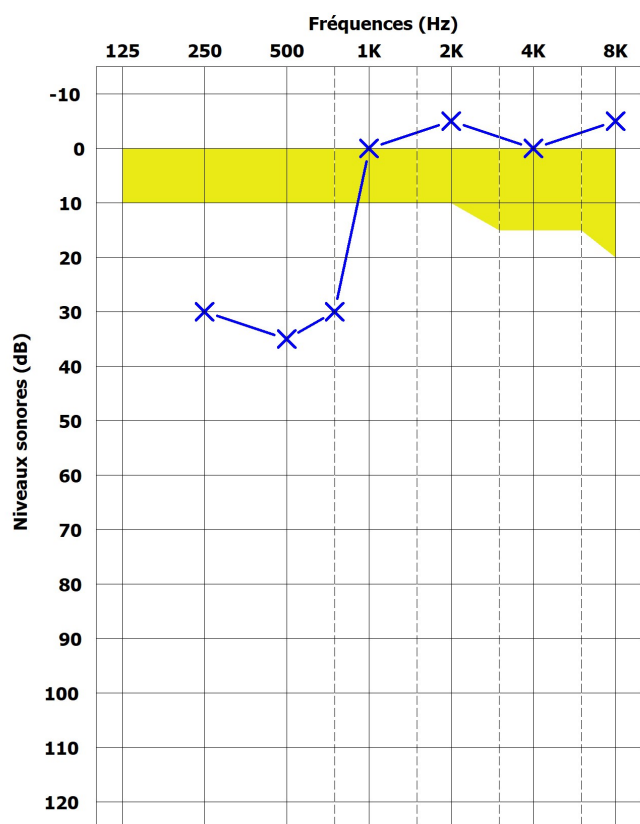

Oreille Gauche

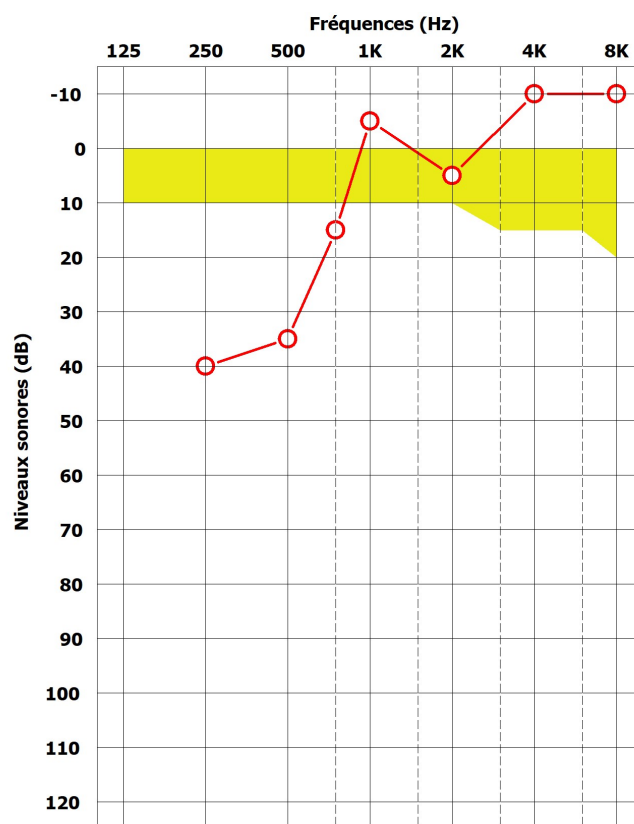

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	35	30	0		-5		0		-5
CA Droit		40	35	15	-5		5		-10		-10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes