


MEDVIE


Date du test: 14/08/2024 13:18:39
Durée: 3mn 00s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA Mohamed	
Date de naissance	16/02/1998
Age	26
Société	CHEC
ID	24081413023419755

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

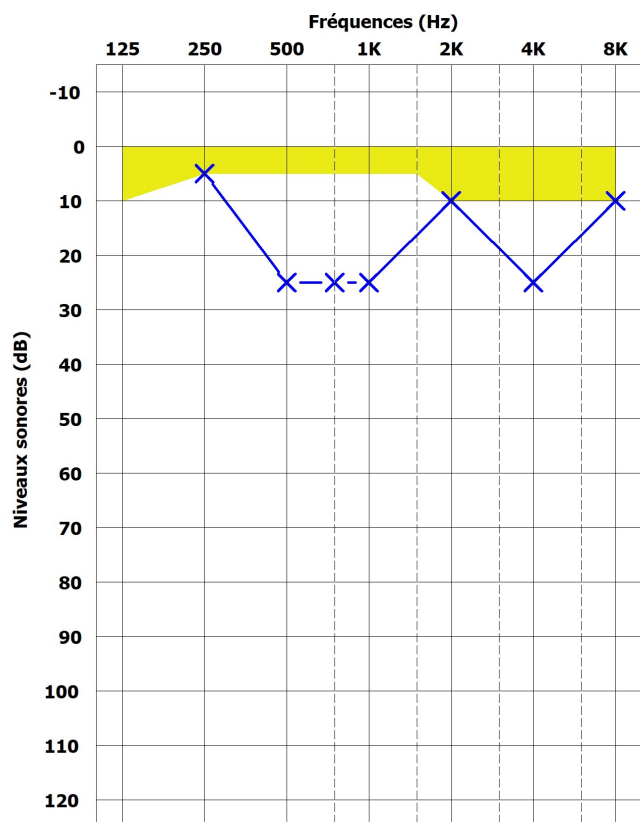

Oreille Gauche

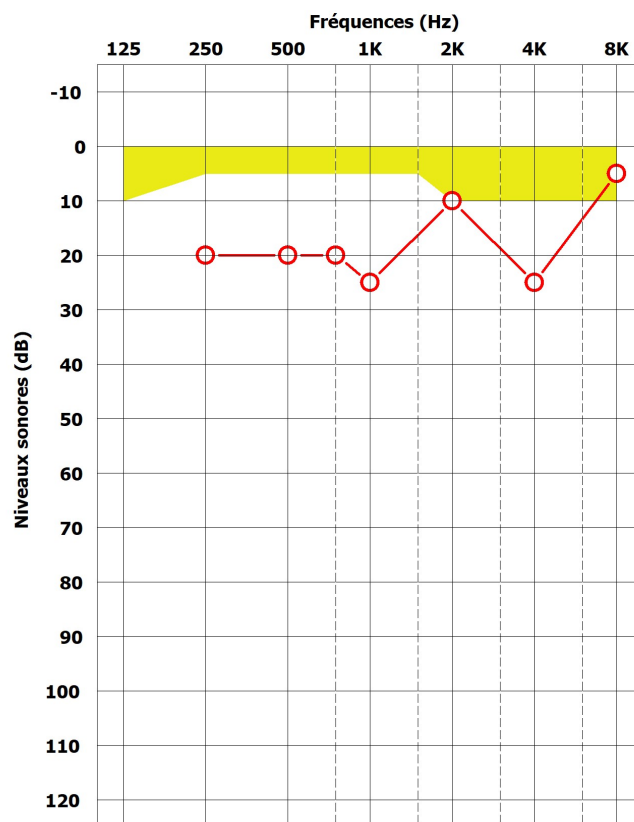

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	25	25	25		10		25		10
CA Droit		20	20	20	25		10		25		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes