


MEDVIE


Date du test: 17/07/2024 17:22:26
Durée: 6mn 26s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO ABOUBACAR	
Date de naissance	01/01/1988
Age	36
Société	CHEC
ID	24071717110493380

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

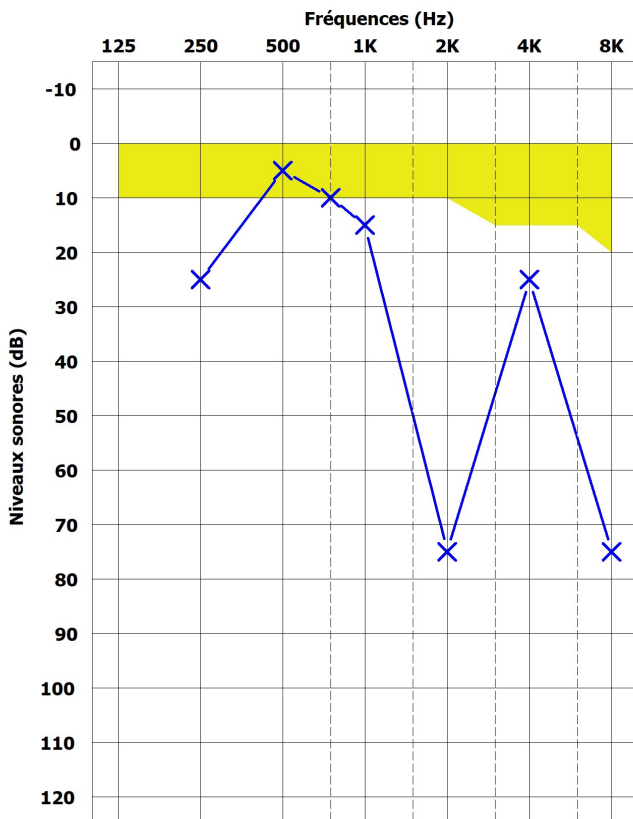

Oreille Gauche

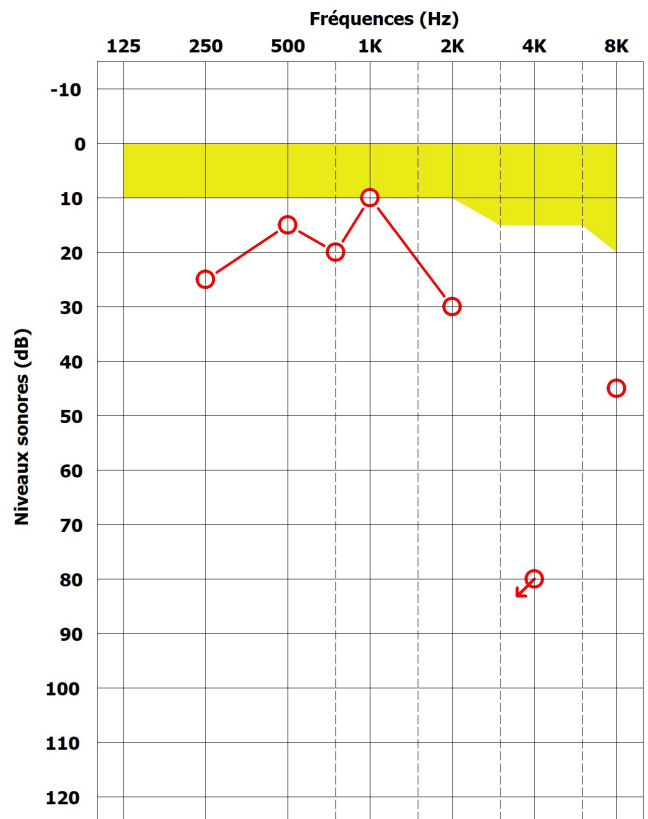

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	5	10	15		75		25		75
CA Droit		25	15	20	10		30		(80)		45

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	30,0 dB	---
CA Droit	---	---

Notes