

Données Patient

BANGOURA ABOUBACAR

Date de naissance

01/01/1992

Age

32

Société

CHEC

ID

24080713222660781

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :


30/11/2021

Date du test: 07/08/2024 13:48:04


Durée: -- mn -- s

Type test

Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

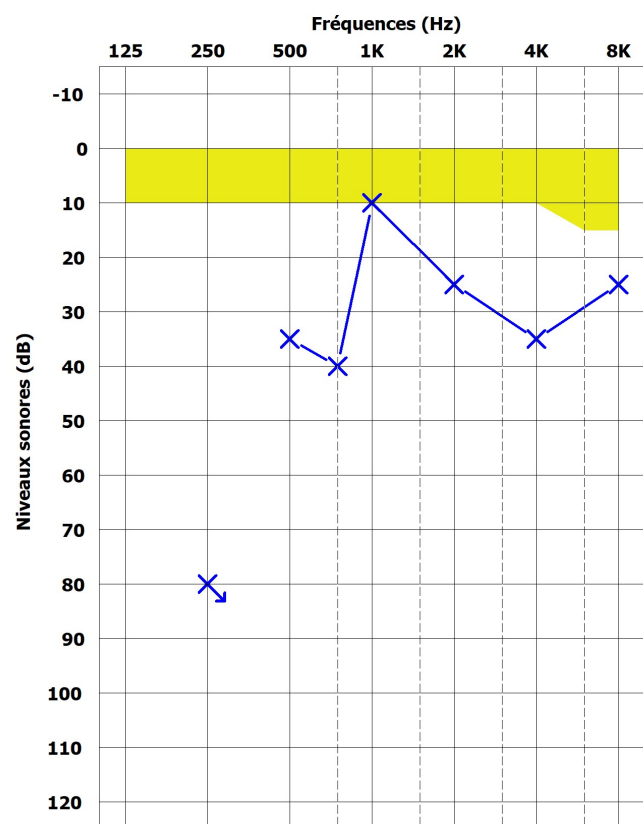

Oreille Gauche

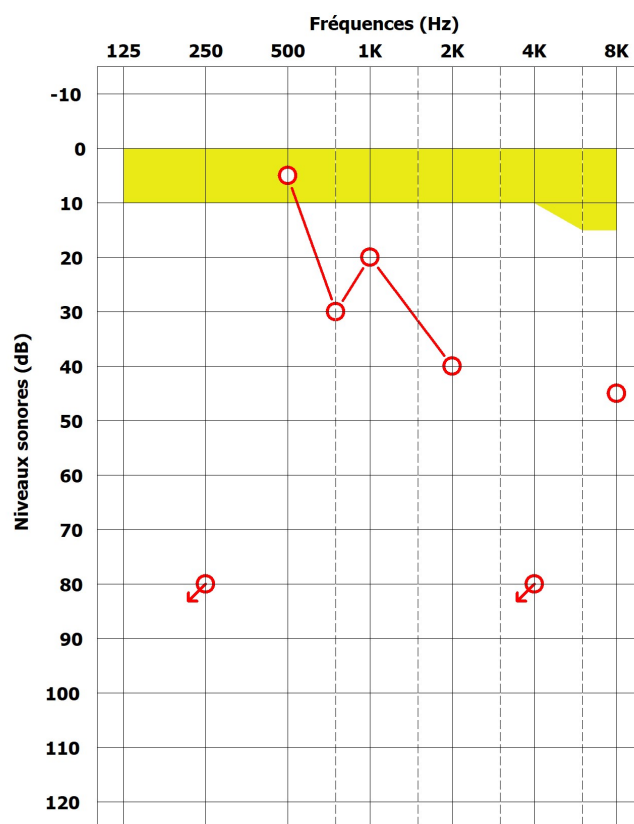

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		(80)	35	40	10		25		35		25
CA Droit		(80)	5	30	20		40		(80)		45

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	---	---

Notes