


MEDVIE


Date du test: 09/08/2024 12:14:34

Durée: 4mn 52s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

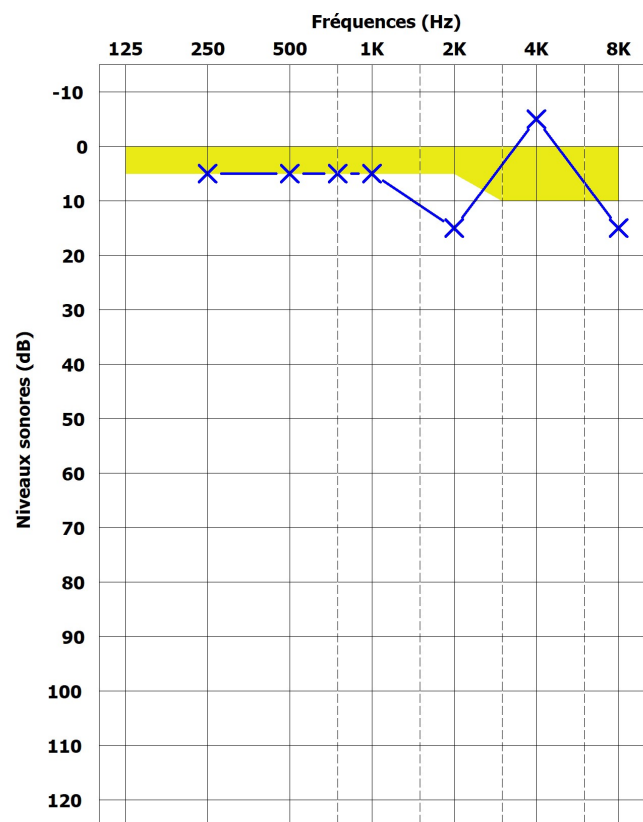

Oreille Gauche

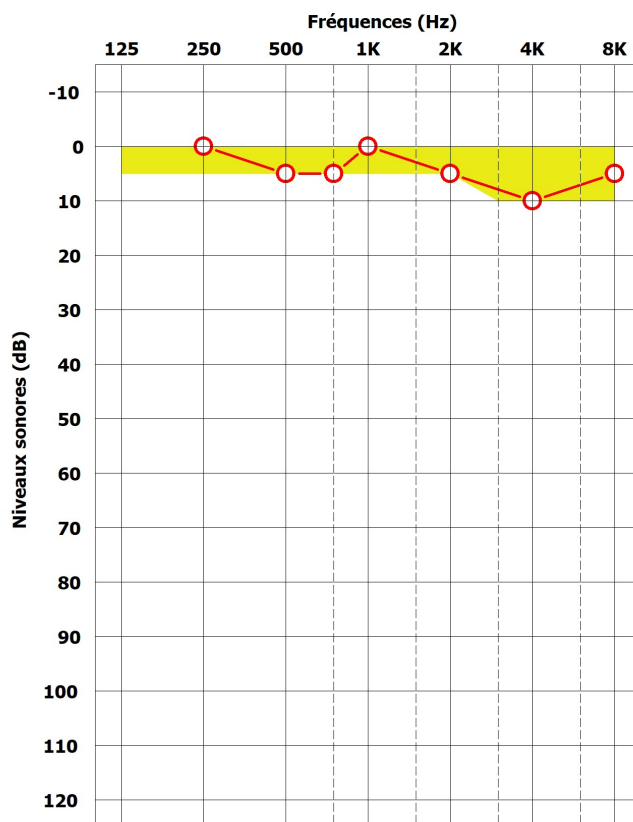

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	5	5	5		15		-5		15
CA Droit		0	5	5	0		5		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes

Données Patient	SOUMA Alhassane
Date de naissance	14/02/2004
Age	20
Société	CHEC
ID	24080912121100773

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021