



Données Patient


SYLLA ABOUBACAR

Date de naissance 02/12/1984
Age 39
Société CHEC
ID 24070519562930106


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 05/07/2024 19:59:05
Durée: 3mn 38s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

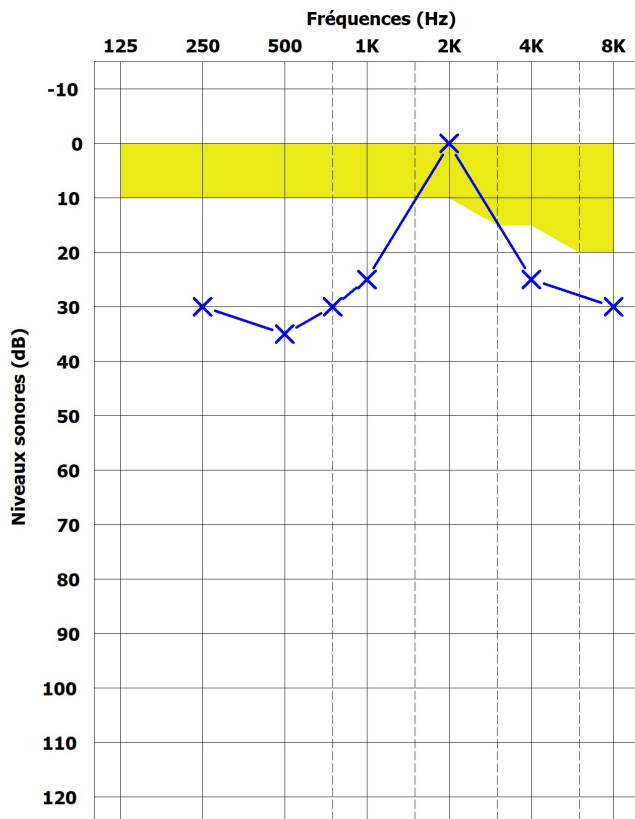

Oreille Gauche

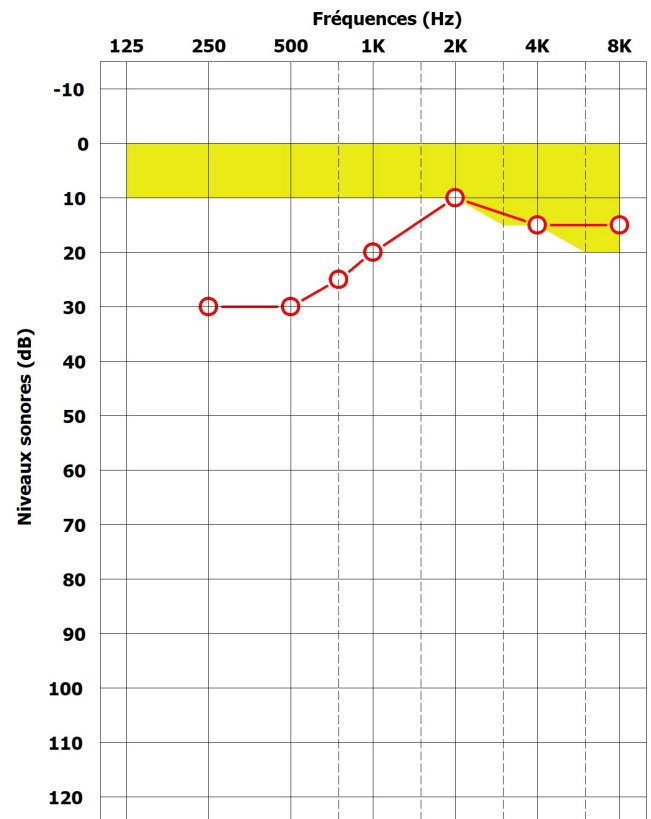

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	35	30	25		0		25		30
CA Droit		30	30	25	20		10		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes