


MEDVIE


Date du test: 14/08/2024 13:13:10  
Durée: 3mn 33s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>CAMARA SALIFOU</b> |                   |
| Date de naissance     | 01/01/1989        |
| Age                   | 35                |
| Société               | CHEC              |
| ID                    | 24081412534896874 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

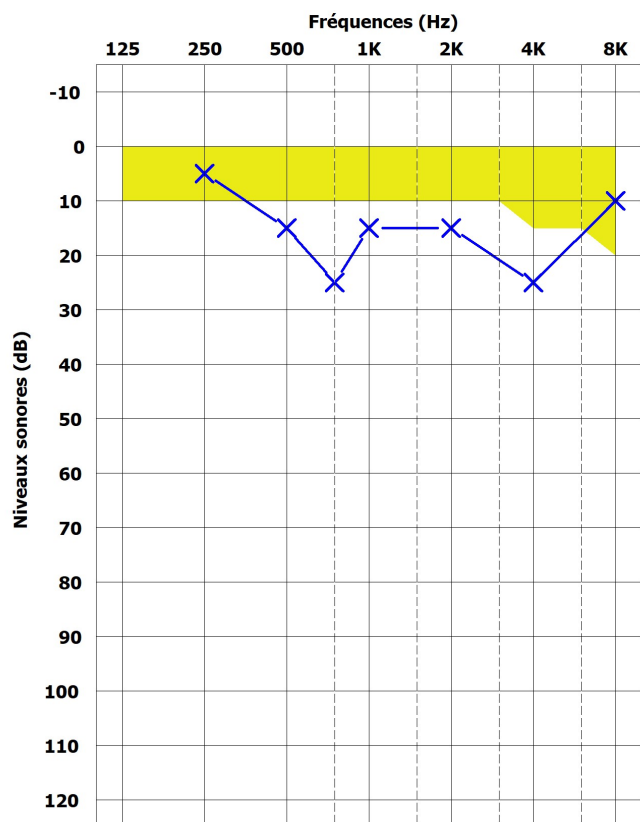

Oreille Gauche

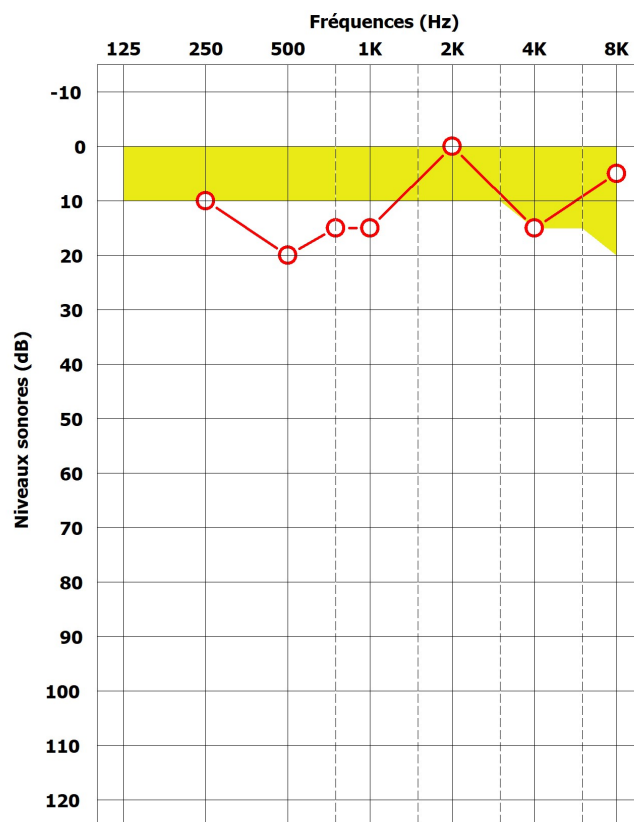

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 5   | 15  | 25  | 15 |     | 15 |    | 25 |    | 10 |
| CA Droit  |     | 10  | 20  | 15  | 15 |     | 0  |    | 15 |    | 5  |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 17,5 dB | --- |
| CA Droit        | 12,5 dB | --- |

Notes