



| Données Patient          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>CAMARA SEKOU MADY</b> |                   |
| Date de naissance        | 04/06/2000        |
| Age                      | 24                |
| Société                  | CHEC              |
| ID                       | 24083114053825661 |

Date du test: 31/08/2024 14:07:09  
 Durée: -- mn -- s  
 Type test Auto  
 Normal  
 Continu  
 Scén. Standard

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

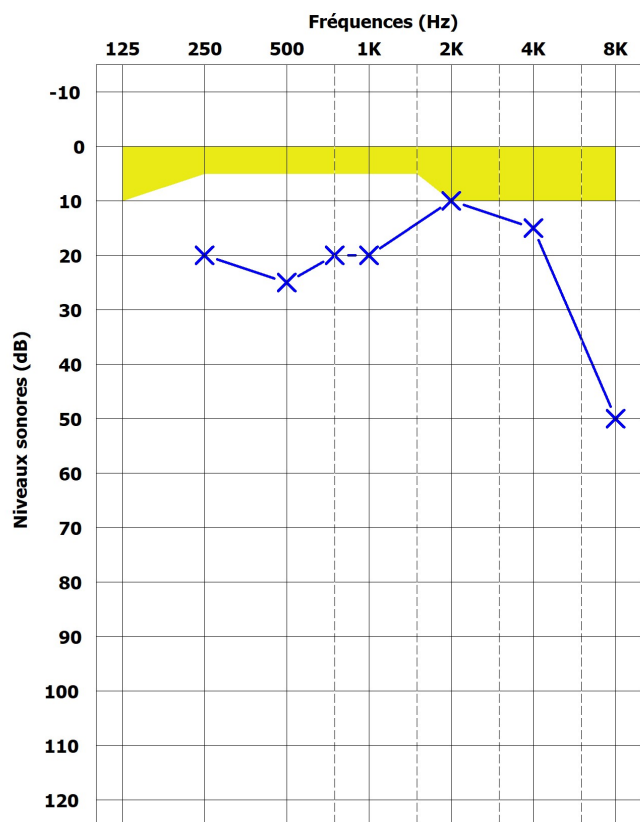

Oreille Gauche

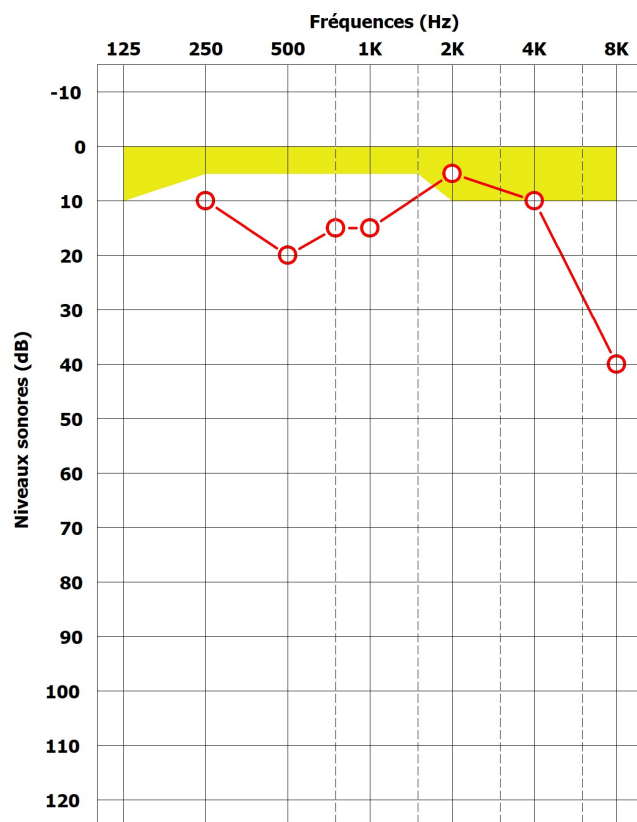

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 20  | 25  | 20  | 20 |     | 10 |    | 15 |    | 50 |
| CA Droit  |     | 10  | 20  | 15  | 15 |     | 5  |    | 10 |    | 40 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 17,5 dB | --- |
| CA Droit        | 12,5 dB | --- |

Notes