


MEDVIE


Date du test: 14/08/2024 14:00:28
Durée: 5mn 04s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SOUMAH MOUSTAPHA	
Date de naissance	01/01/1991
Age	33
Société	CHEC
ID	24081413561452155

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

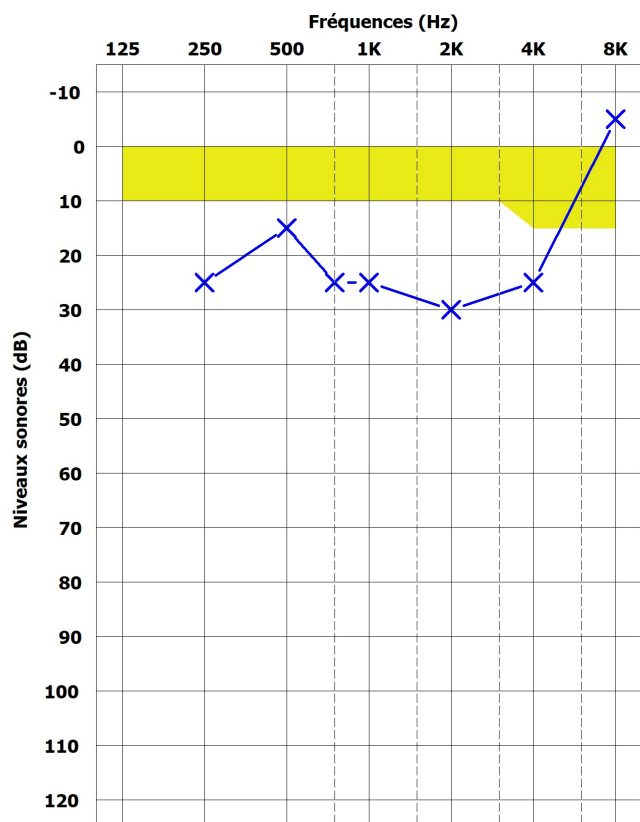

Oreille Gauche

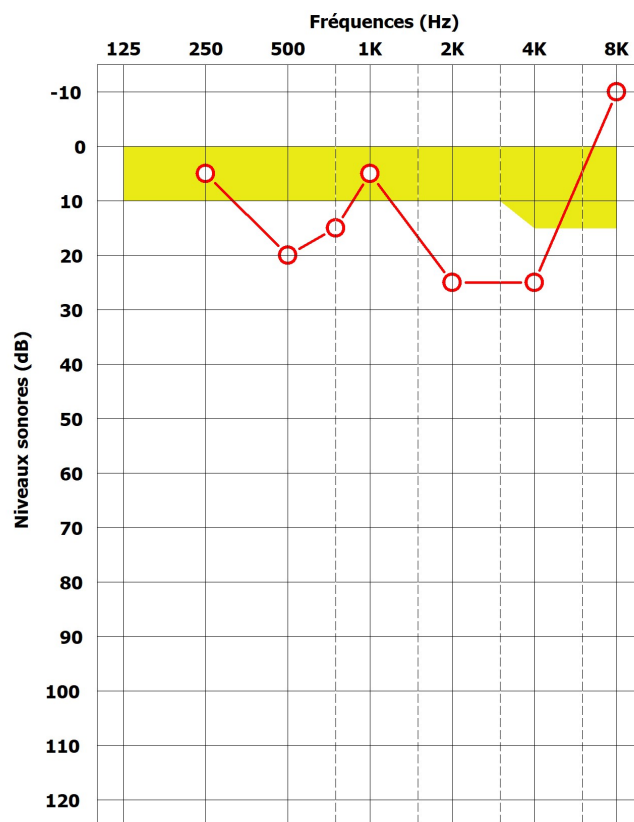

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	15	25	25		30		25		-5
CA Droit		5	20	15	5		25		25		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes