

Données Patient


FOFANA FODE

Date de naissance 01/01/1996
Age 28
Société CHEC
ID 24070519193185124


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 05/07/2024 19:21:38
Durée: 3mn 56s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

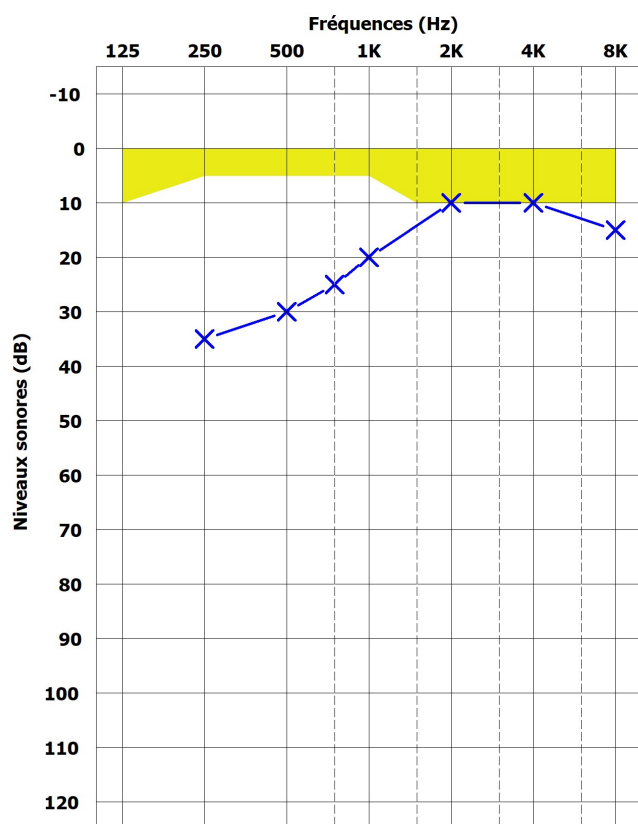

Oreille Gauche

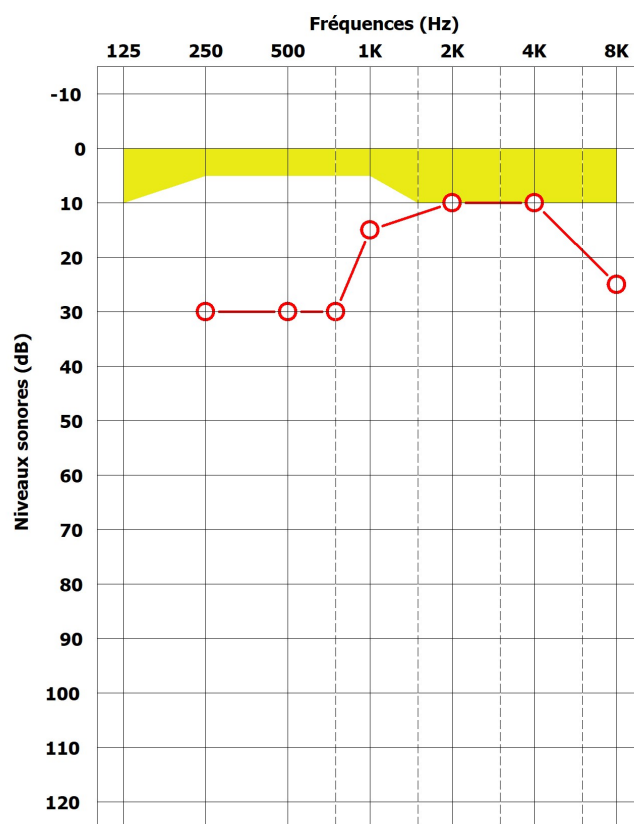

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	30	25	20		10		10		15
CA Droit		30	30	30	15		10		10		25

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes