

MEDVIE

Date du test: 08/09/2024 14:31:05

Durée: 4mn 12s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient **CISSE MORLAYE KARO**

Date de naissance 01/01/1980

Age 44

Société CHEC


ID 24090814180094686

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

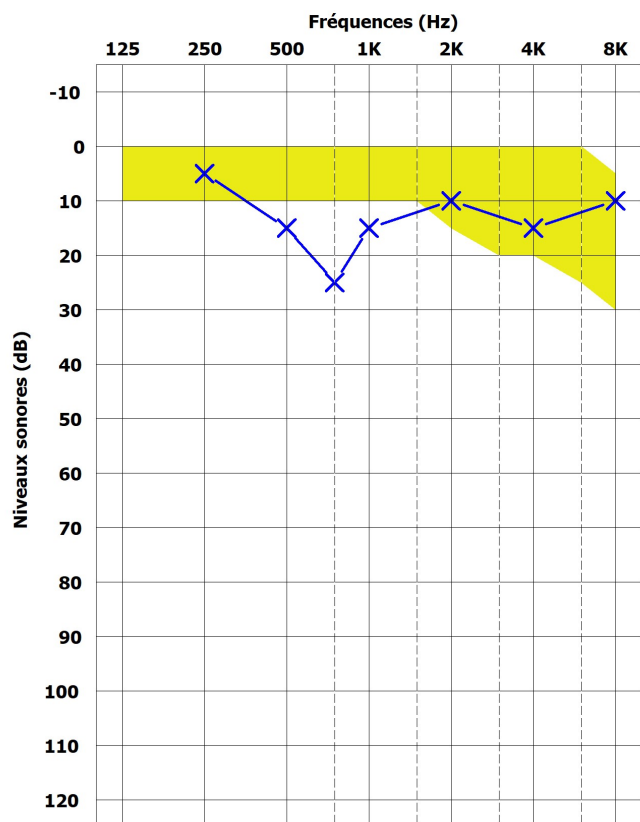

Oreille Gauche

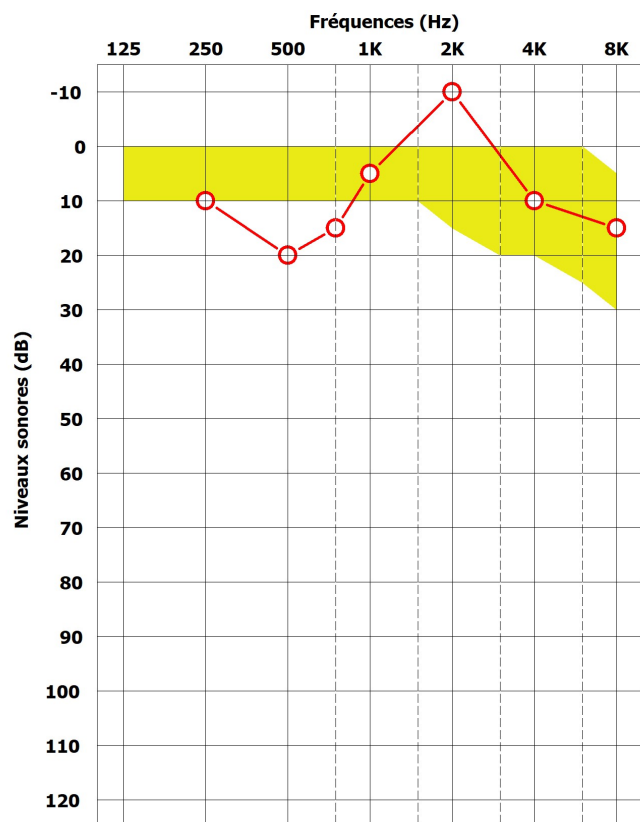

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	15	25	15		10		15		10
CA Droit		10	20	15	5		-10		10		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes