


MEDVIE


Date du test: 17/07/2024 20:11:43
Durée: 4mn 33s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO MAMOUDOU	
Date de naissance	20/02/2001
Age	23
Société	CHEC
ID	24071720085085152

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

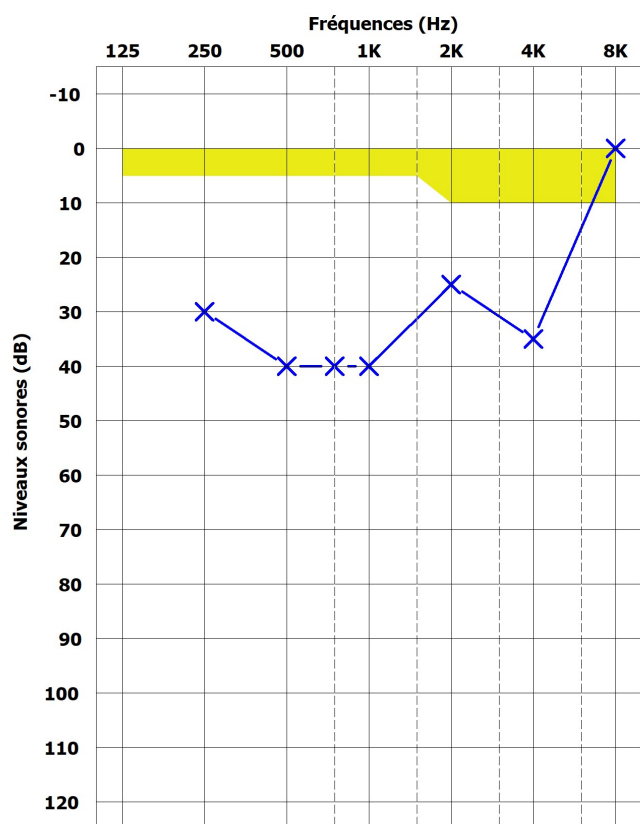

Oreille Gauche

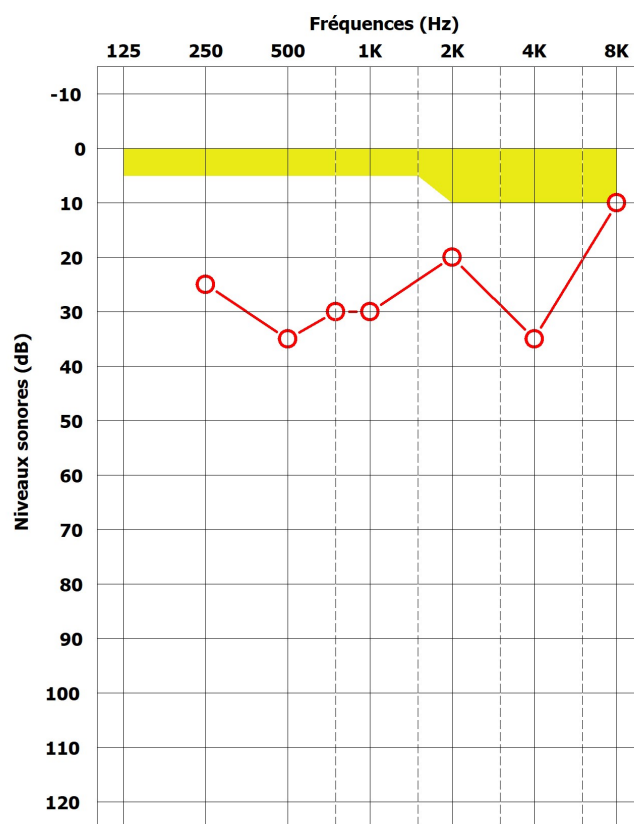

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	40	40	40		25		35		0
CA Droit		25	35	30	30		20		35		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	35,0 dB	---
CA Droit	30,0 dB	---

Notes