


MEDVIE


Date du test: 14/08/2024 17:01:01
Durée: 2mn 26s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
SOUMAH ABOUBACAR M'MA	
Date de naissance	10/10/1987
Age	36
Société	CHEC
ID	24081416394201583

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

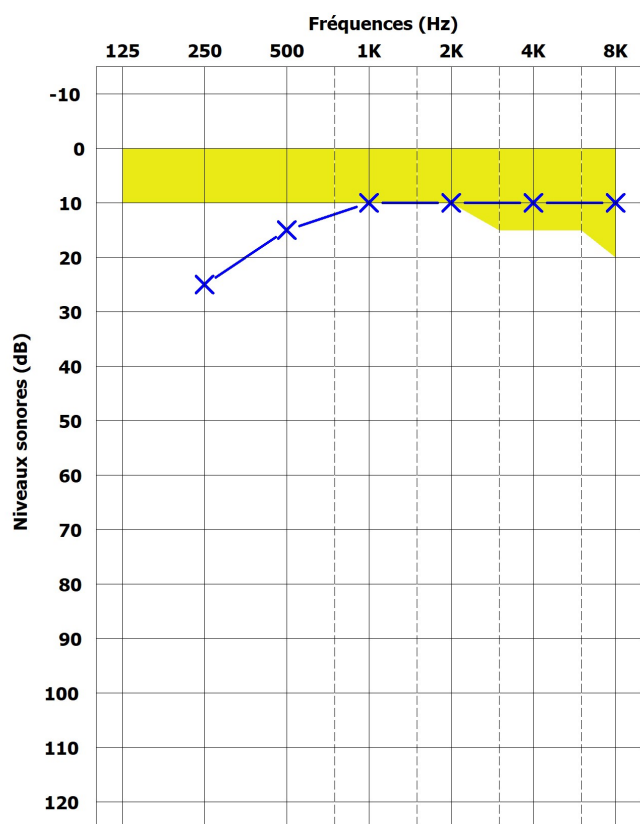

Oreille Gauche

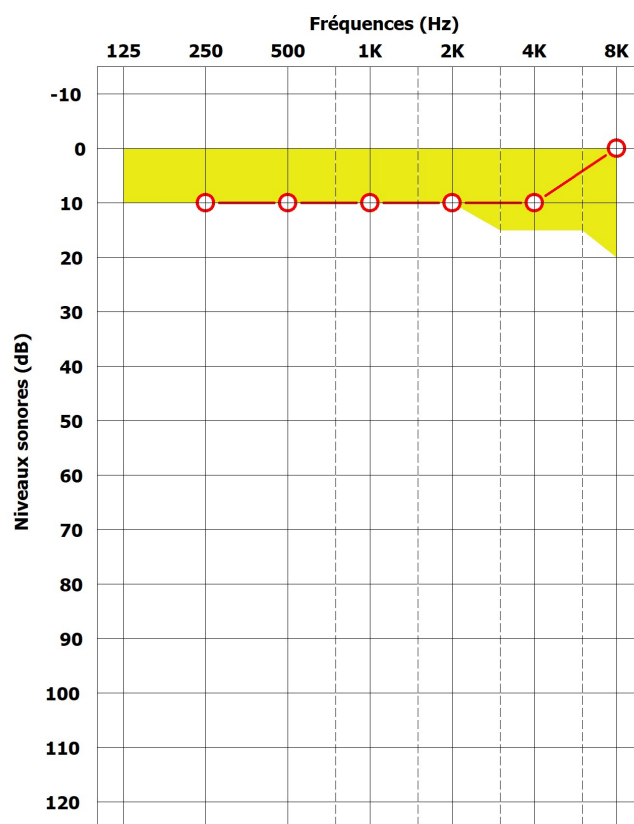

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	15		10		10		10		10
CA Droit		10	10		10		10		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes