



Données Patient	
<b>CAMARA MOHAMED</b>	
Date de naissance	01/01/1982
Age	42
Société	CHEC
ID	24070306311143622

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

Date du test: 03/07/2024 06:33:39  
 Durée: -- mn -- s  
 Type test Manuel  
 Continu

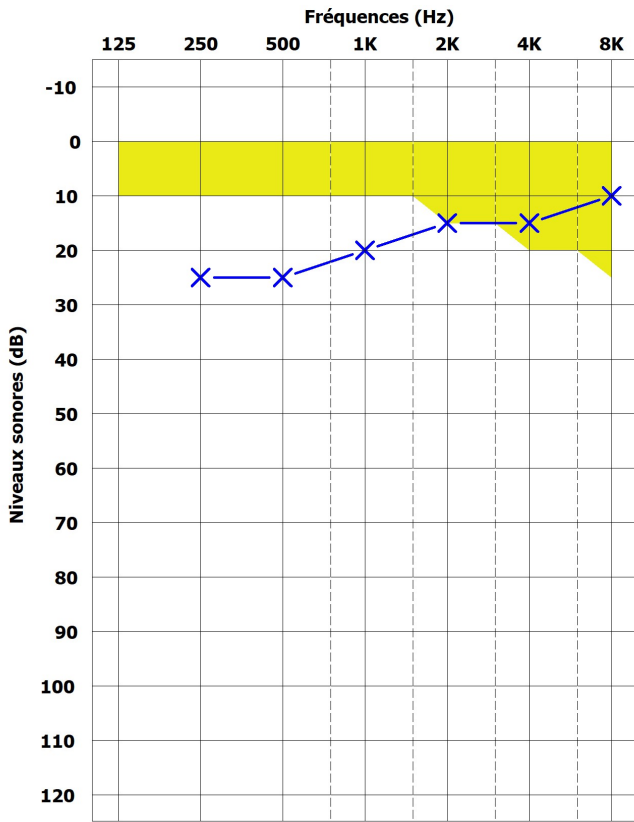

Oreille Gauche

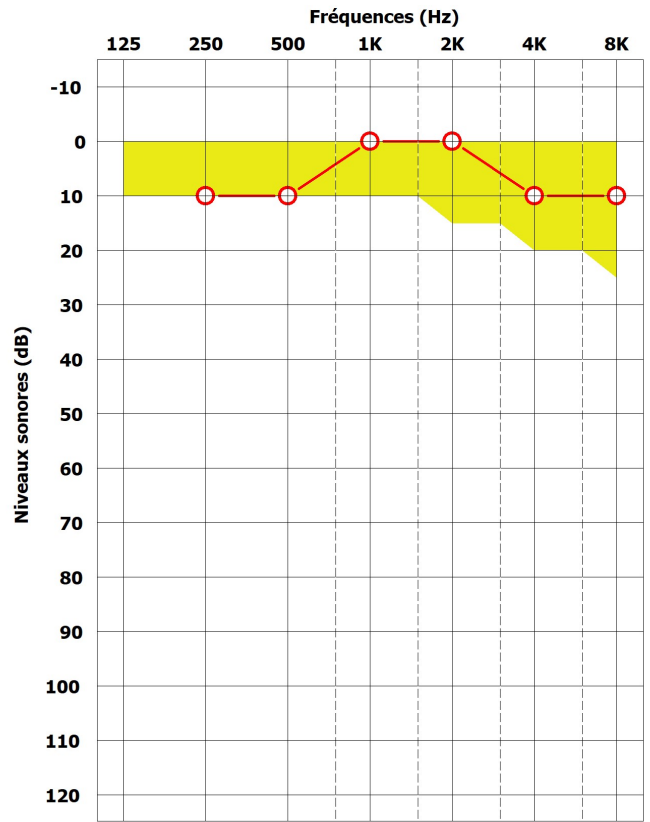

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25		20		15		15		10
CA Droit		10	10		0		0		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
	CA Gauche	18,8 dB
CA Droit	5,0 dB	---

Notes