


MEDVIE


Date du test: 07/08/2024 11:27:29
Durée: 3mn 49s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
Date de naissance	01/01/1991
Age	33
Société	CHEC
ID	24080711192636651

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

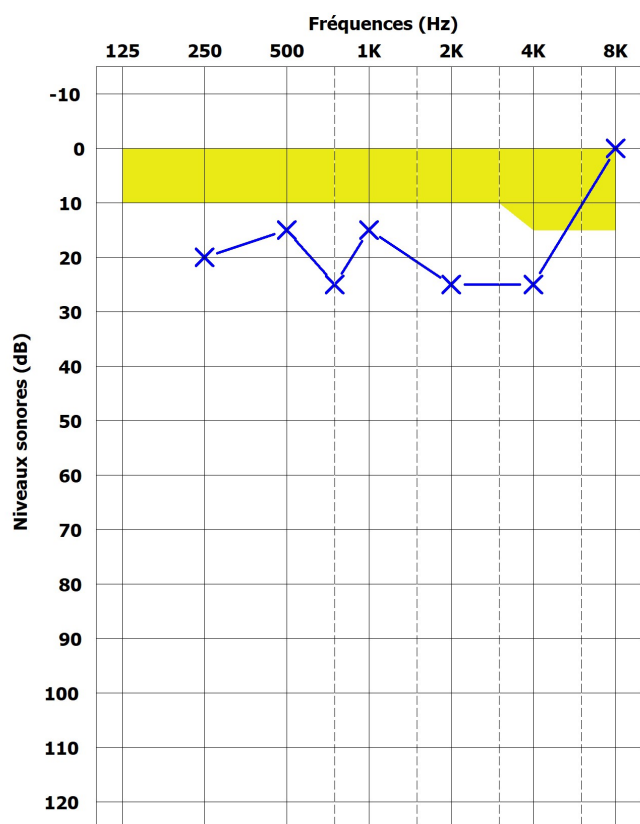

Oreille Gauche

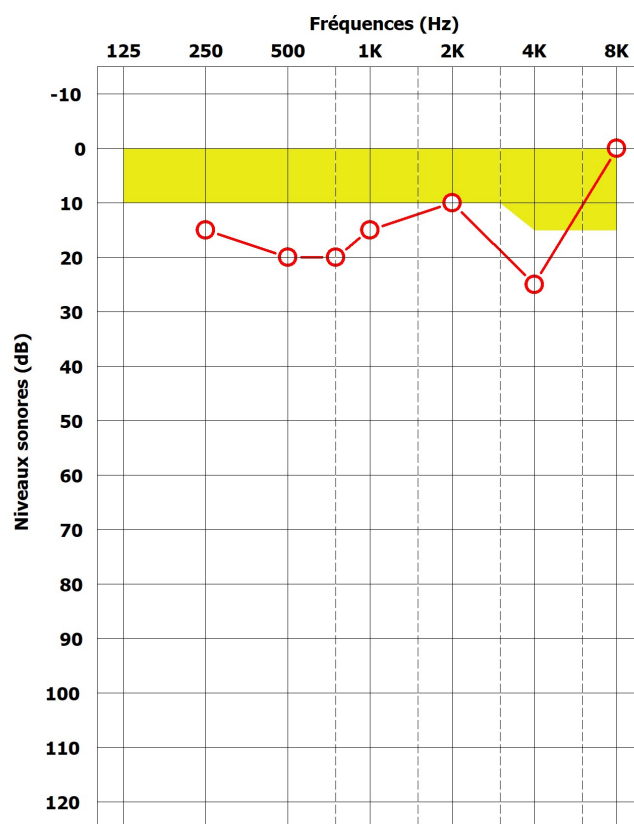

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	15	25	15		25		25		0
CA Droit		15	20	20	15		10		25		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes