



Données Patient

KEITA FODE SAMBA

Date de naissance

01/01/1968

Age

56

Société

CHEC

ID

24070515501549501

Date du test: 05/07/2024 15:51:53

Durée: 3mn 25s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021

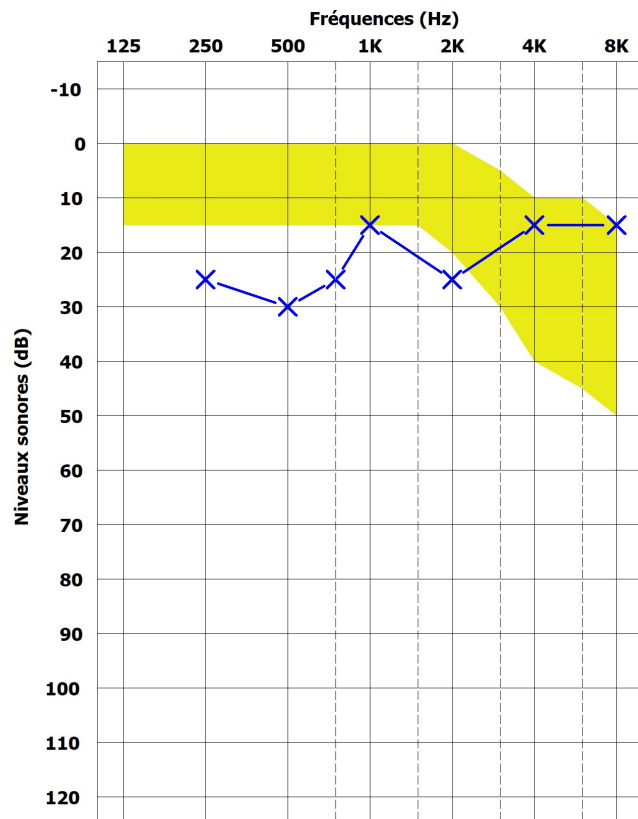

Oreille Gauche

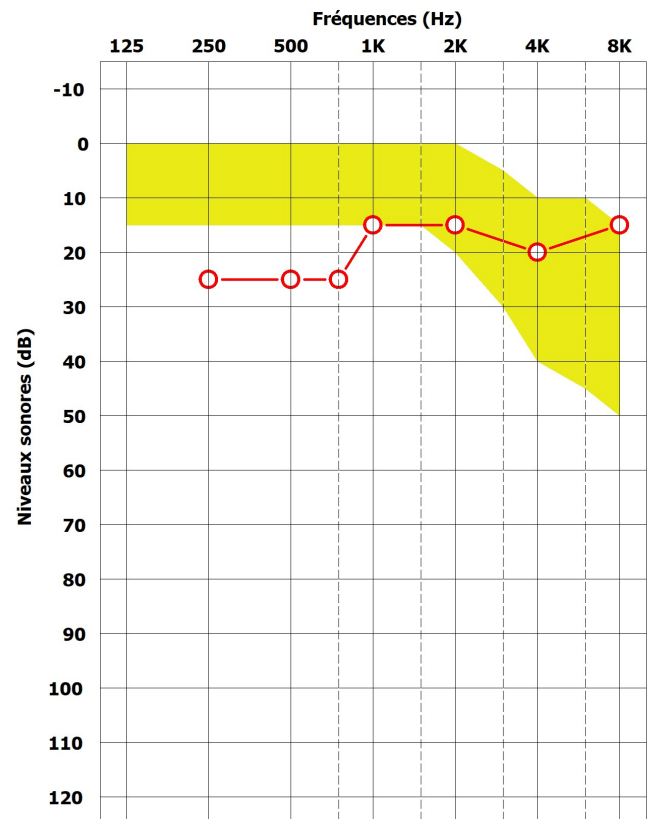

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	25	15		25		15		15
CA Droit		25	25	25	15		15		20		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes