


MEDVIE


Date du test: 14/08/2024 16:47:24
Durée: 1mn 41s
Type test Manuel
Continu

Données Patient		KONE SIBA
Date de naissance	14/01/1993	
Age	31	
Société	CHEC	
ID	24081416310978909	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

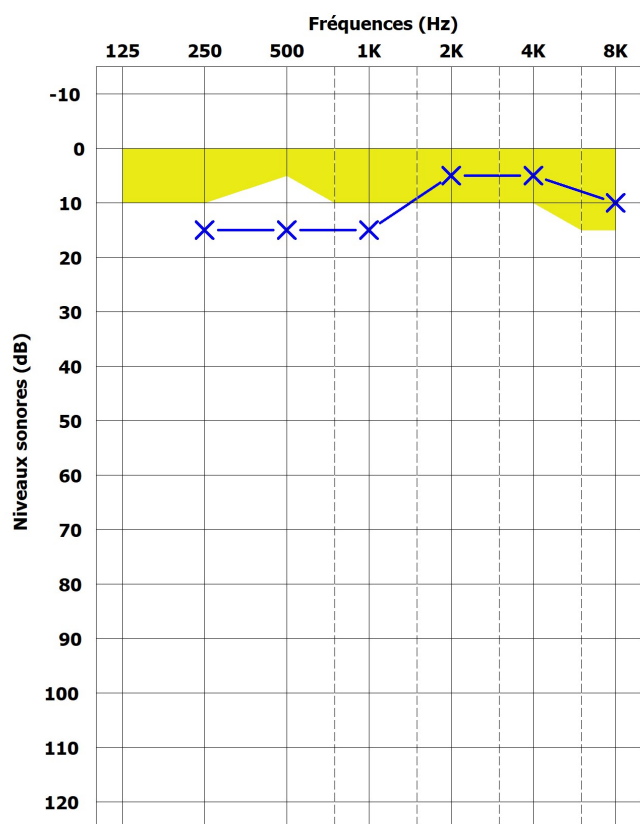

Oreille Gauche

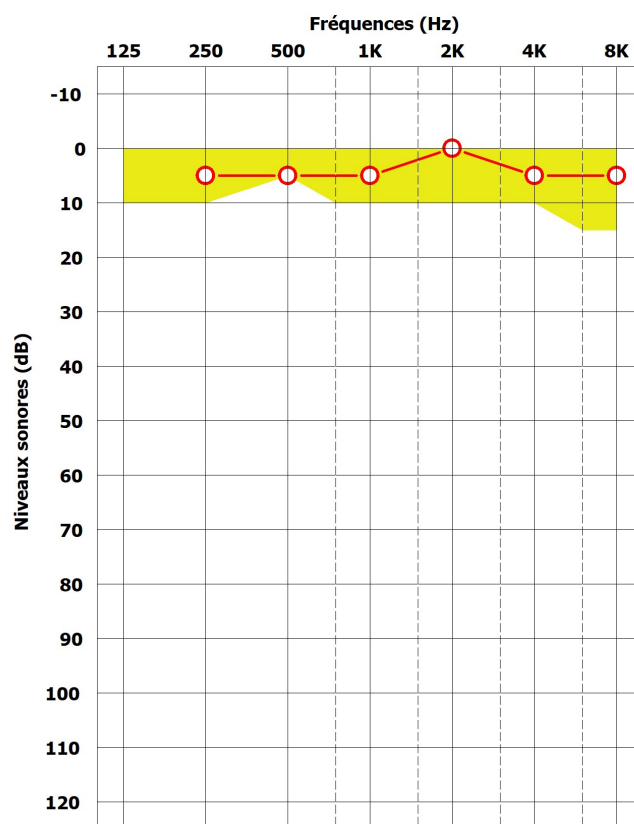

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15		15		5		5		10
CA Droit		5	5		5		0		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes