



Données Patient


CISSE MOUCTAR

Date de naissance 08/02/2002
Age 22
Société CHEC
ID 24070611220054933


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 06/07/2024 11:24:17
Durée: 4mn 34s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

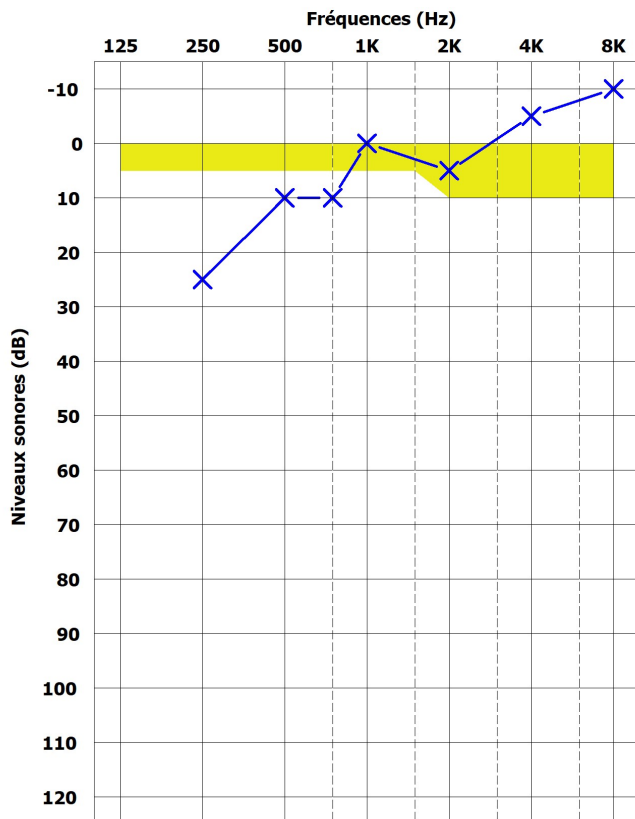

Oreille Gauche

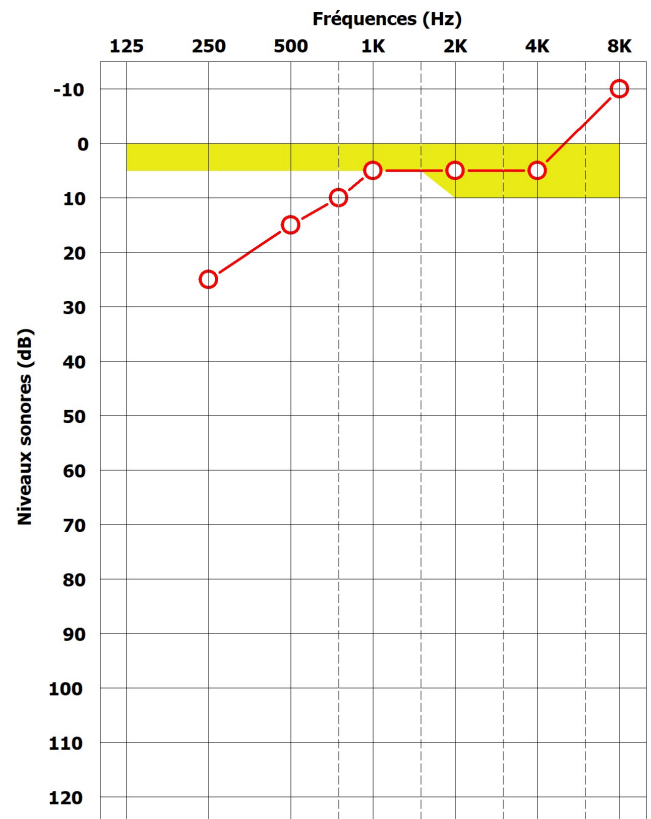

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	10	10	0		5		-5		-10
CA Droit		25	15	10	5		5		5		-10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes