

MEDVIE


Date du test: 15/07/2024 15:17:06

Durée: 3mn 08s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BANGOURA FODE	
Date de naissance	01/01/2000
Age	24
Société	CHEC
ID	24071515094183961

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

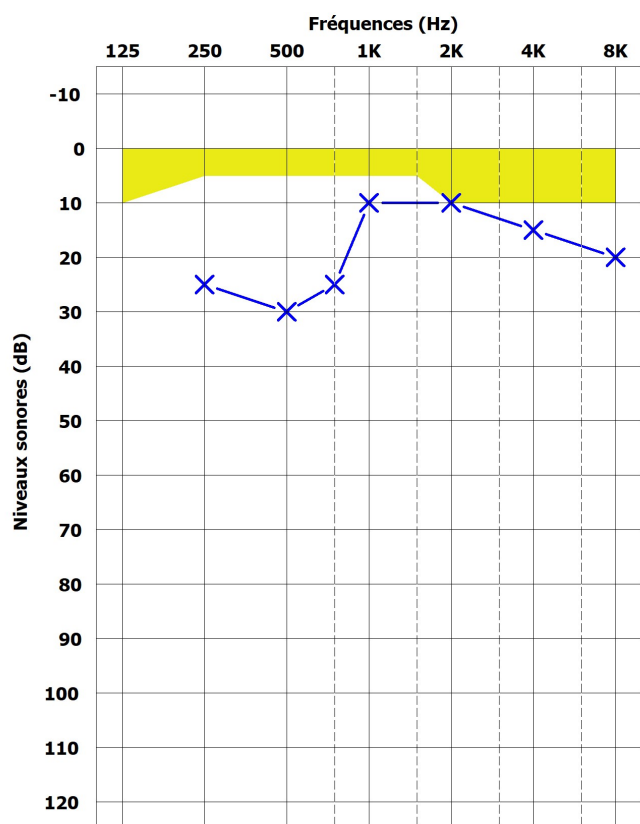

Oreille Gauche

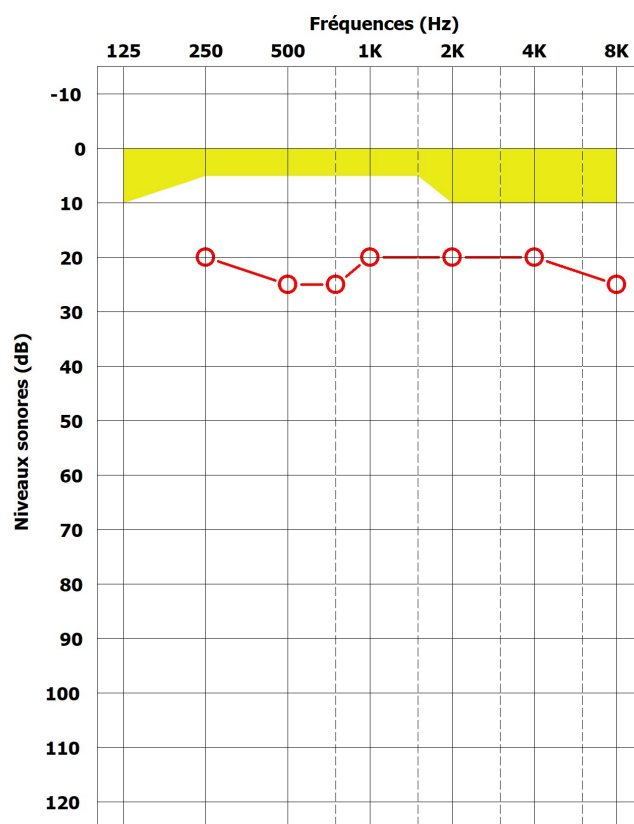

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	25	10		10		15		20
CA Droit		20	25	25	20		20		20		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes