


MEDVIE


Date du test: 14/08/2024 12:42:35
Durée: 6mn 06s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
FOFANA SEKOU AHMED	
Date de naissance	02/03/2002
Age	22
Société	CHEC
ID	24081412304467127

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

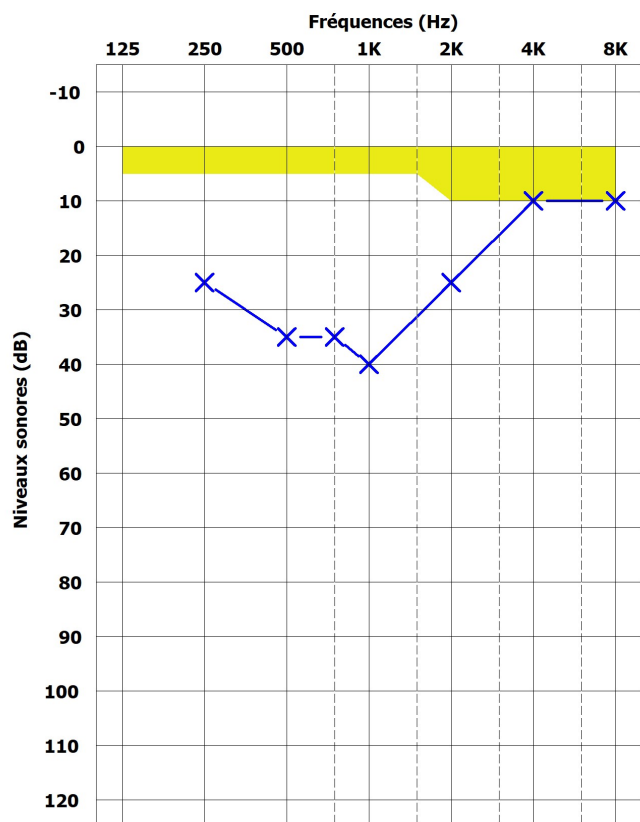

Oreille Gauche

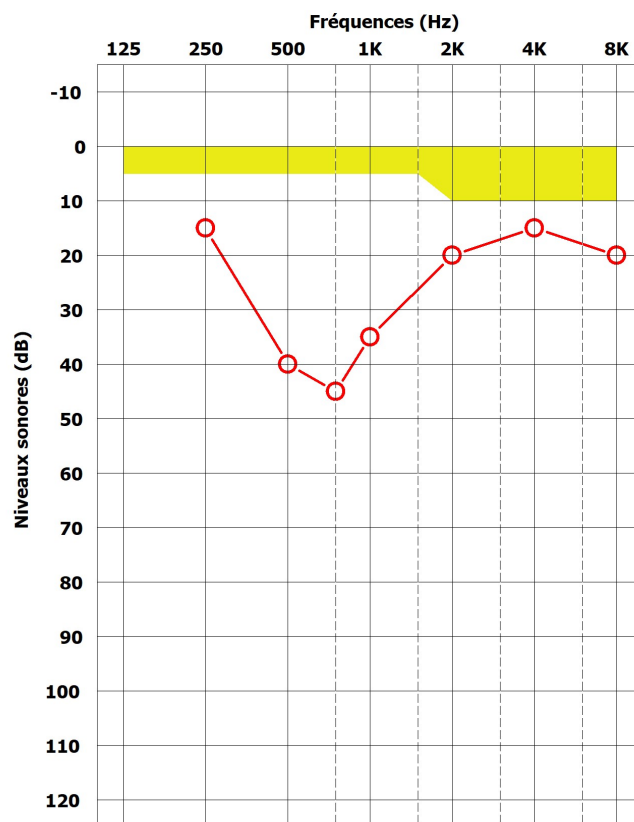

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	35	35	40		25		10		10
CA Droit		15	40	45	35		20		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	27,5 dB	---
CA Droit	27,5 dB	---

Notes